

MEDVIE

Date du test: 01/07/2025 15:08:18

Durée: 4mn 32s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **ZHANG CHANGLONG**

Date de naissance 03/09/1981

Age 43

Société CR18


ID 25070115044619007

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

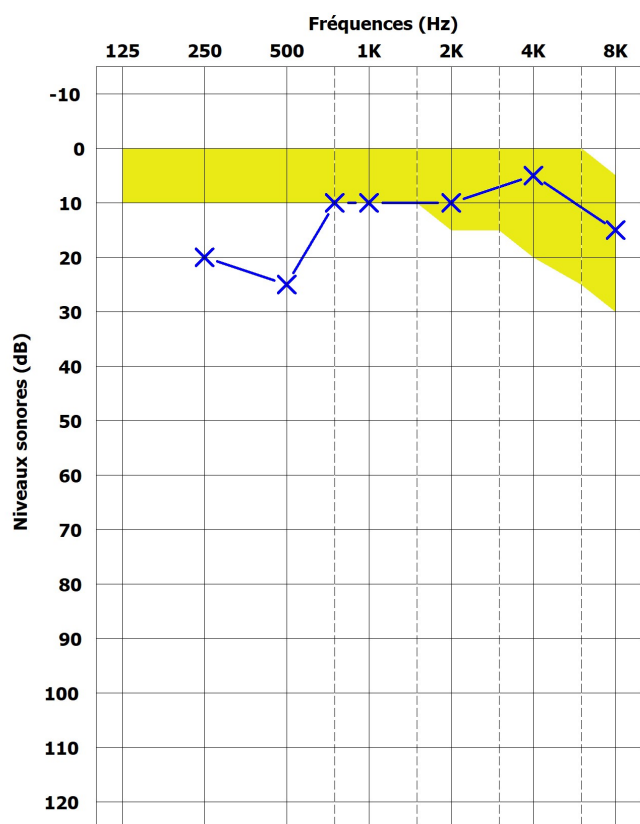

Oreille Gauche

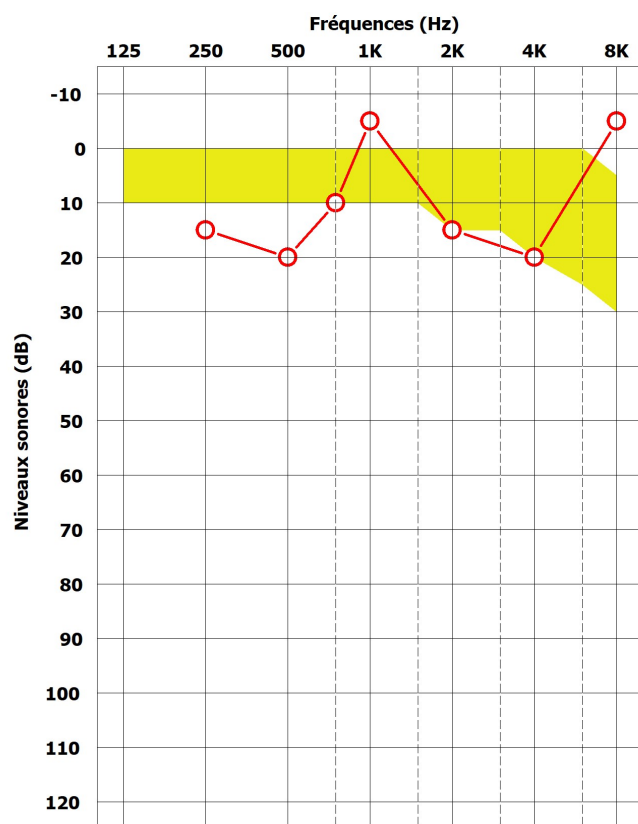

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	10	10		10		5		15
CA Droit		15	20	10	-5		15		20		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes