


MEDVIE


Date du test: 18/04/2024 12:40:41

Durée: 10mn 04s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

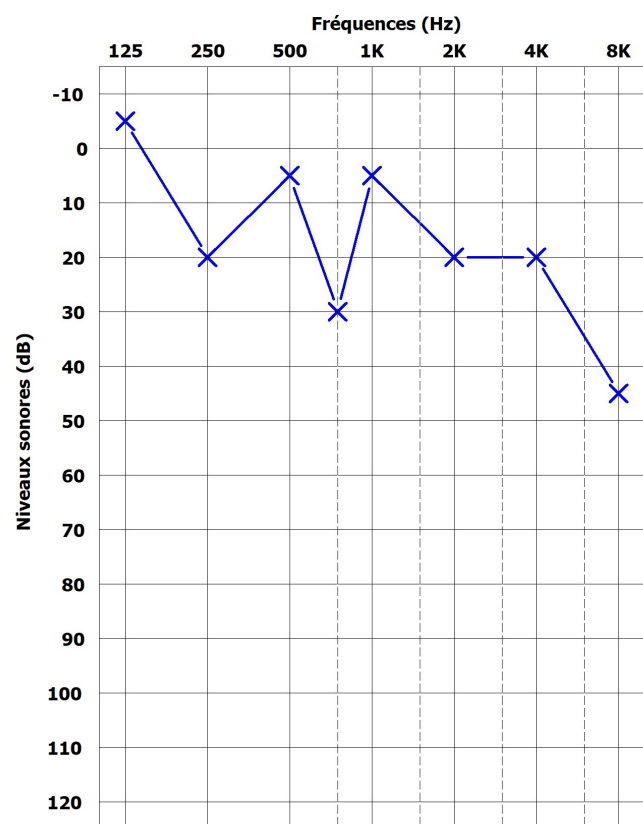

Oreille Gauche

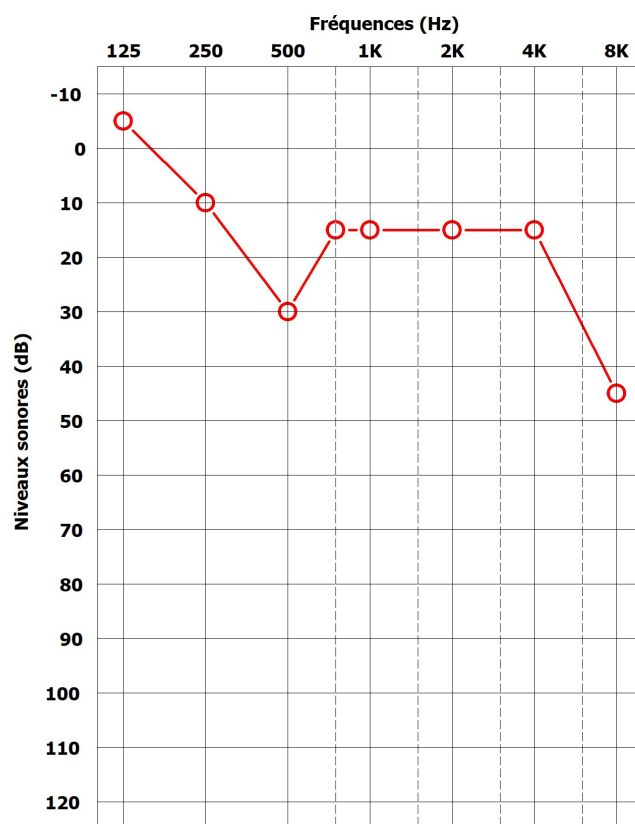

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	-5	20	5	30	5		20		20		45
CA Droit	-5	10	30	15	15		15		15		45

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes

Données Patient	KOUYATE SEKOU
Date de naissance	01/01/1985
Age	39
Société	CR18
ID	24041812384078543

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021