

MEDVIE


Date du test: 05/03/2025 17:58:47

Durée: 4mn 41s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TRAORE SIDIKI
Date de naissance	01/01/2001
Age	24
Société	CR18
ID	25030515041253840

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

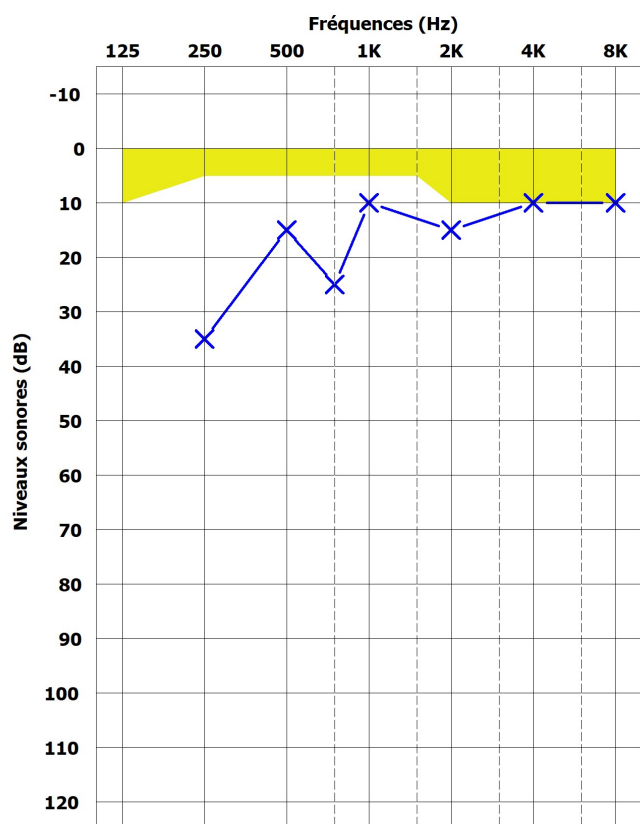

Oreille Gauche

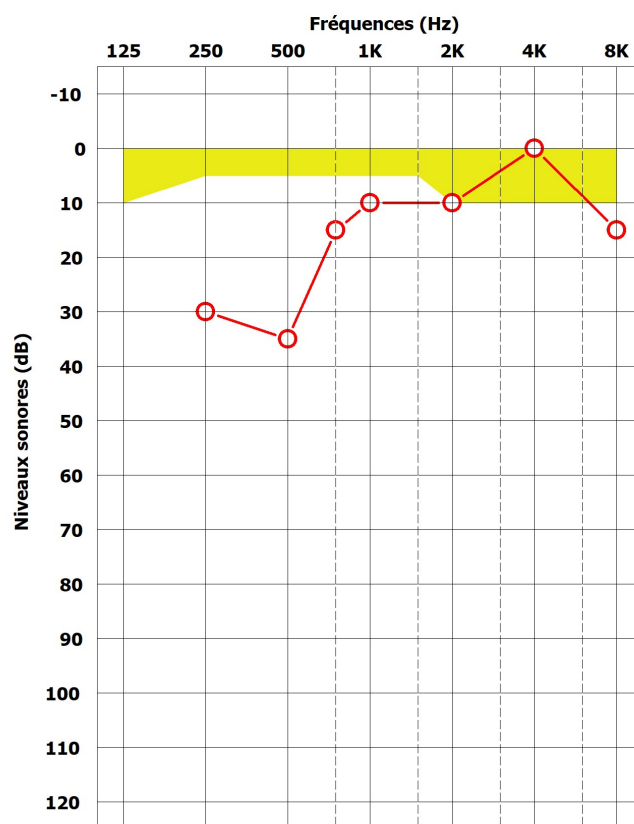

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	15	25	10		15		10		10
CA Droit		30	35	15	10		10		0		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes