

MEDVIE


Date du test: 26/03/2024 10:18:45

Durée: 12mn 07s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SAGNO MOHAMED	
Date de naissance	04/03/1998
Age	26
Société	CR18
ID	24032610152016992

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

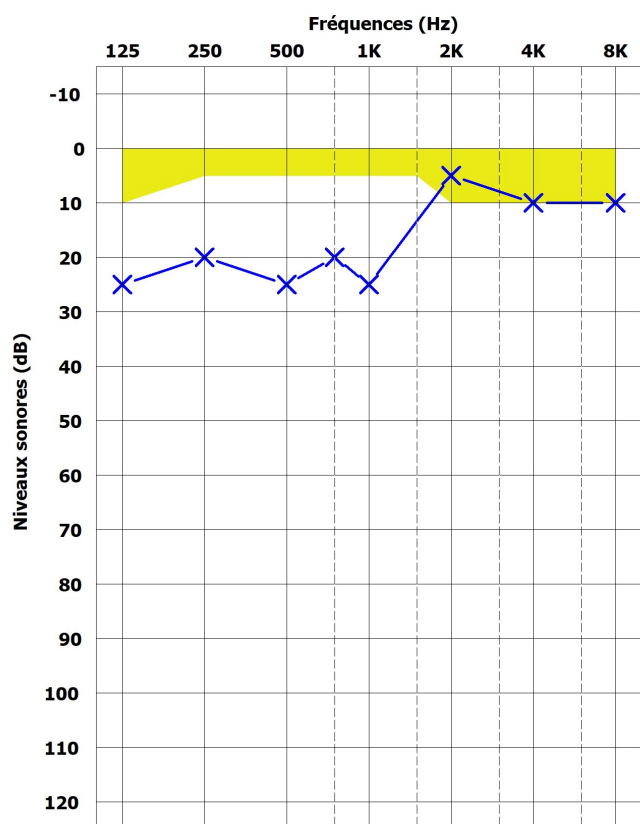

Oreille Gauche

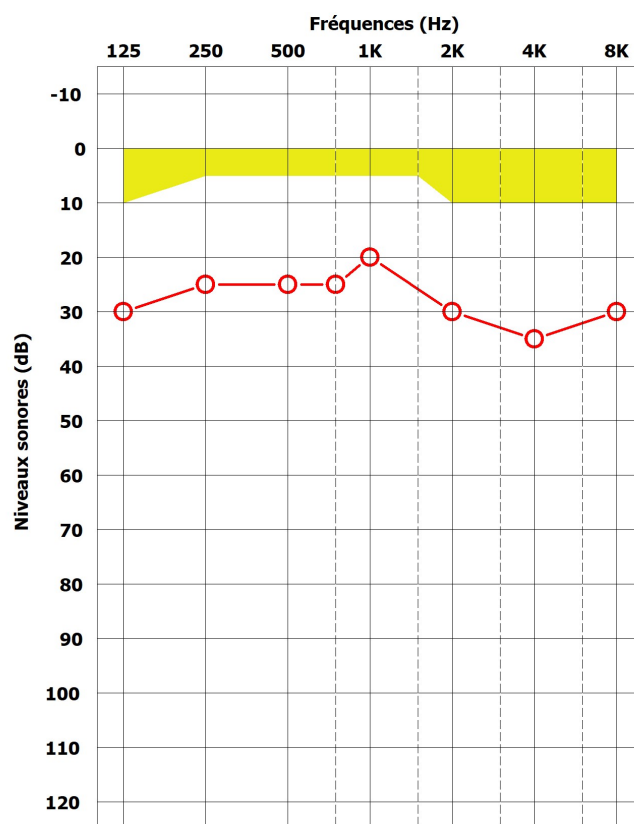

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	25	20	25		5		10		10
CA Droit	30	25	25	25	20		30		35		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	27,5 dB	---

Notes