


MEDVIE


Date du test: 24/05/2024 11:55:58  
Durée: -- mn -- s  
Type test Manuel  
Continu

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| SOUMAH MOUSSA     |                   |
| Date de naissance | 01/01/1999        |
| Age               | 25                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 24052411530670781 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

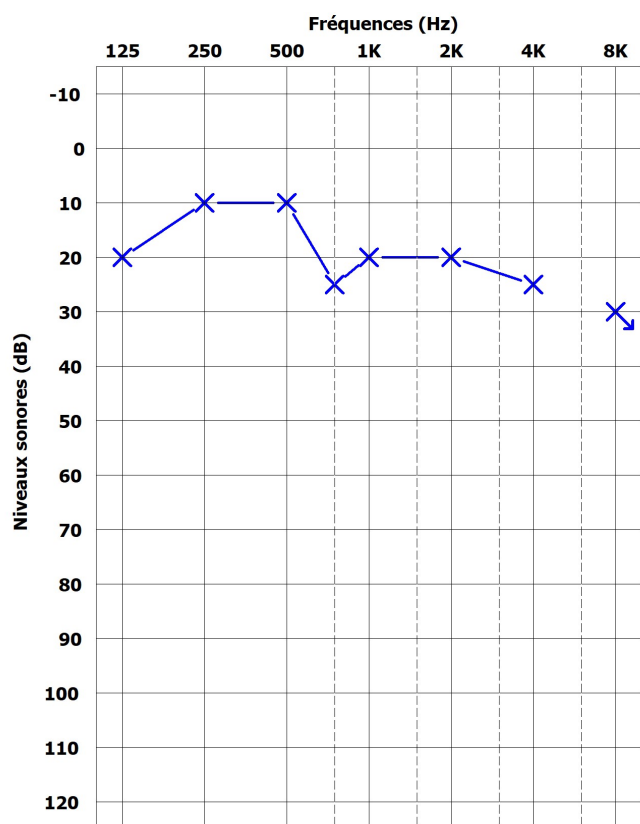

Oreille Gauche

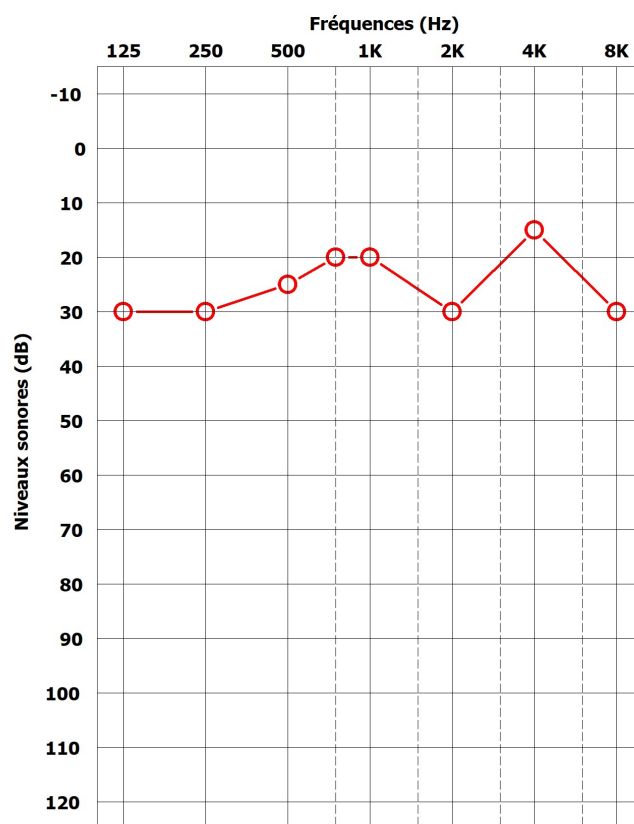

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|------|
| CA Gauche | 20  | 10  | 10  | 25  | 20 |     | 20 |    | 25 |    | (30) |
| CA Droit  | 30  | 30  | 25  | 20  | 20 |     | 30 |    | 15 |    | 30   |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 18,8 dB | --- |
| CA Droit        | 22,5 dB | --- |

Notes