
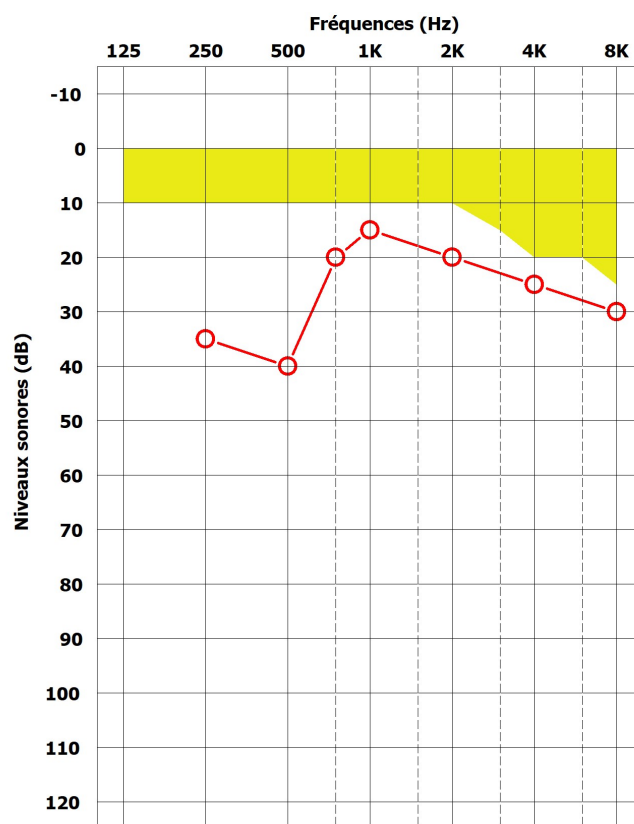


MEDVIE

Date du test: 05/03/2025 17:12:53
Durée: 3mn 31s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA MORY	
Date de naissance	18/04/1984
Age	40
Société	CR18
ID	25030516073994292

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

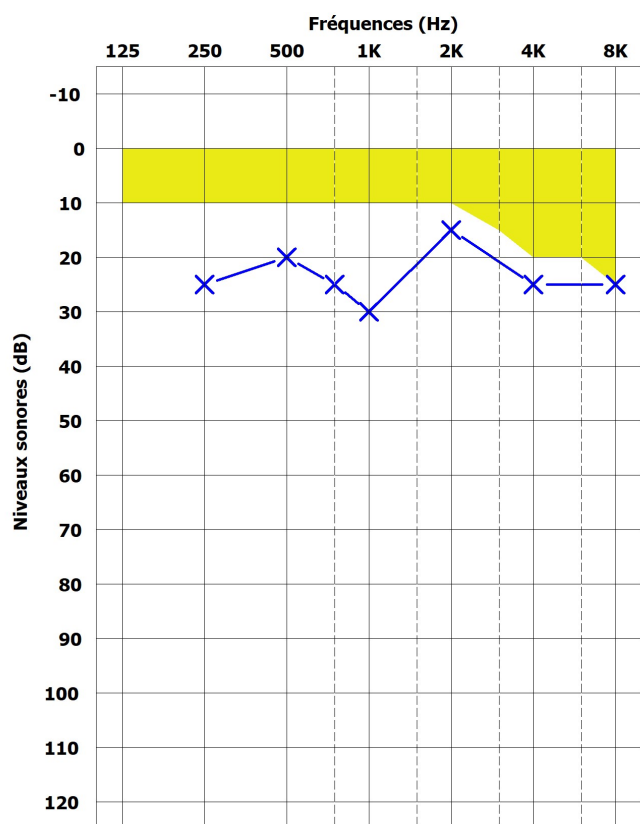

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	25	30		15		25		25
CA Droit		35	40	20	15		20		25		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes