

MEDVIE


Date du test: 22/04/2024 11:32:34

Durée: 11mn 36s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DOUKOURE YOUSOUF
Date de naissance	05/03/1993
Age	31
Société	CR18
ID	24042211284890852

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

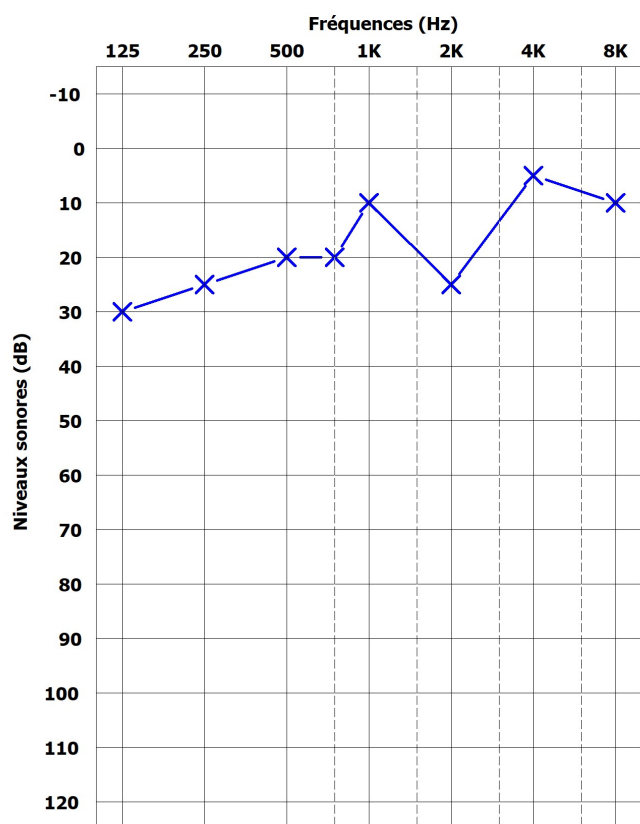

Oreille Gauche

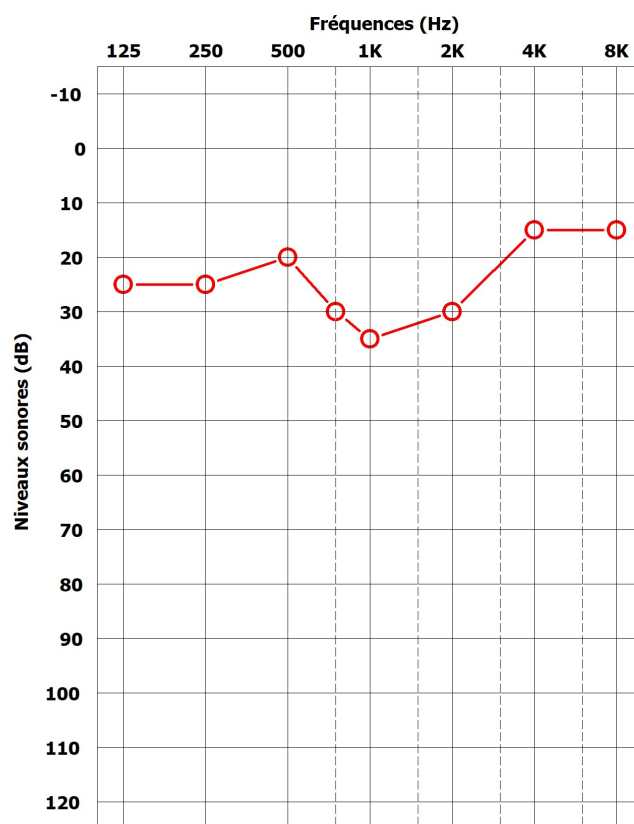

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	25	20	20	10		25		5		10
CA Droit	25	25	20	30	35		30		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes