

MEDVIE


Date du test: 21/08/2025 23:29:47

Durée: 5mn 00s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SYLLA MOUSTAPHA
Date de naissance	06/10/2000
Age	24
Société	CR18
ID	25082116304304354

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

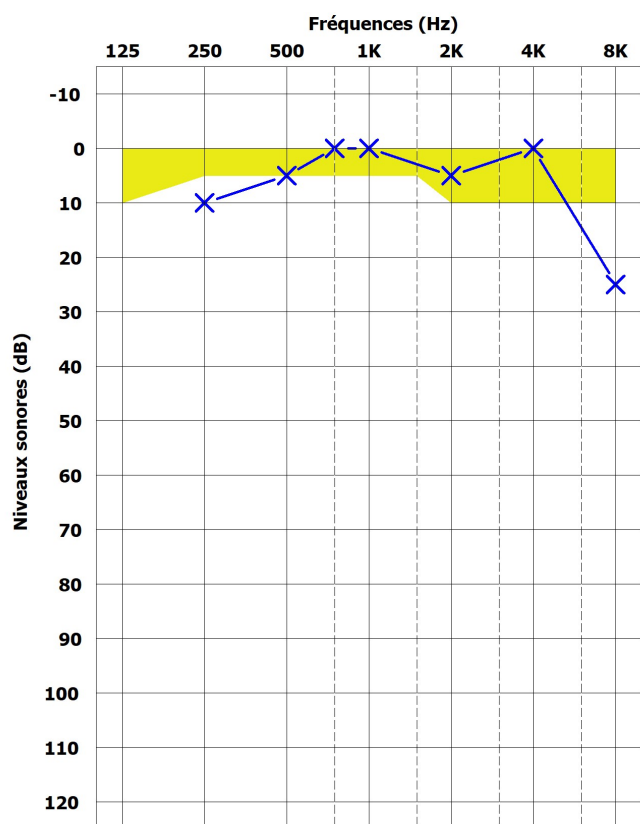

Oreille Gauche

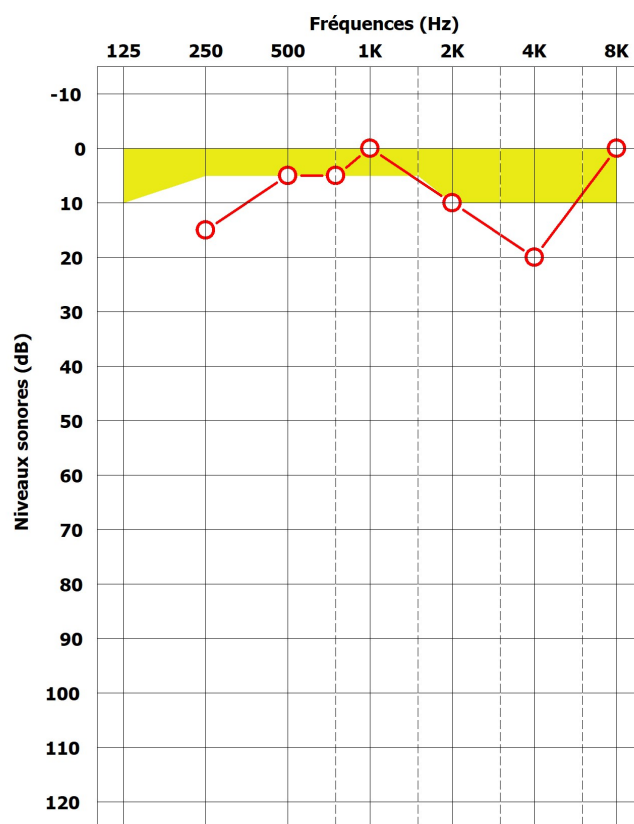

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	5	0	0		5		0		25
CA Droit		15	5	5	0		10		20		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes