


MEDVIE


Date du test: 16/05/2024 11:15:16
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		DIAKITE SARAN
Date de naissance	01/01/1999	
Age	25	
Société	CR18	
ID	24051611071076808	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

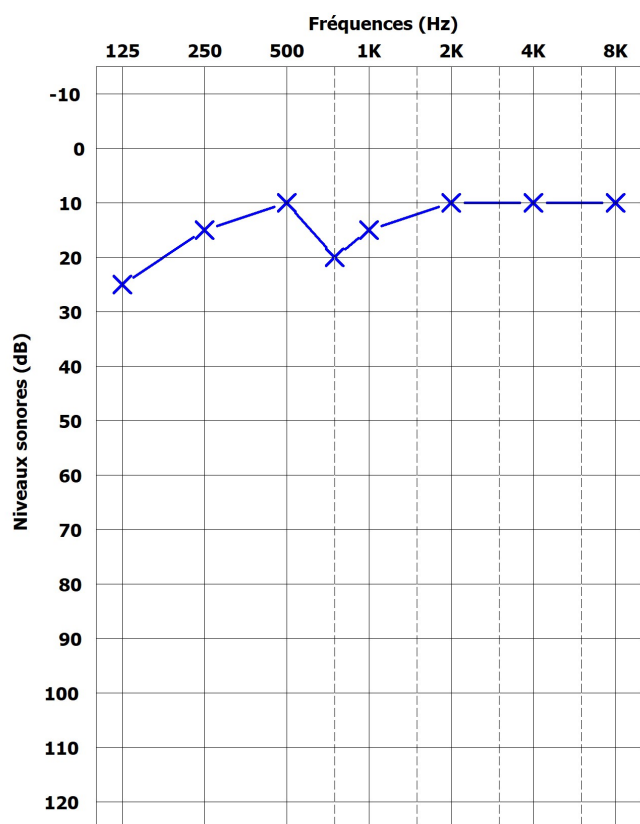

Oreille Gauche

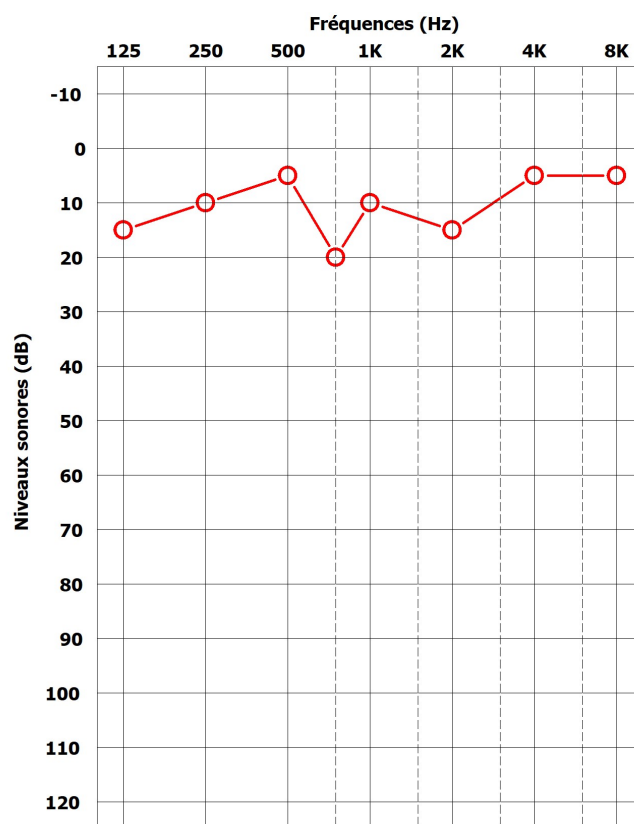

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	15	10	20	15		10		10		10
CA Droit	15	10	5	20	10		15		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes