


MEDVIE


Date du test: 04/07/2025 11:58:34
Durée: 4mn 29s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHANGCHUN LI	
Date de naissance	11/12/1970
Age	54
Société	CR18
ID	25070411533417817

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

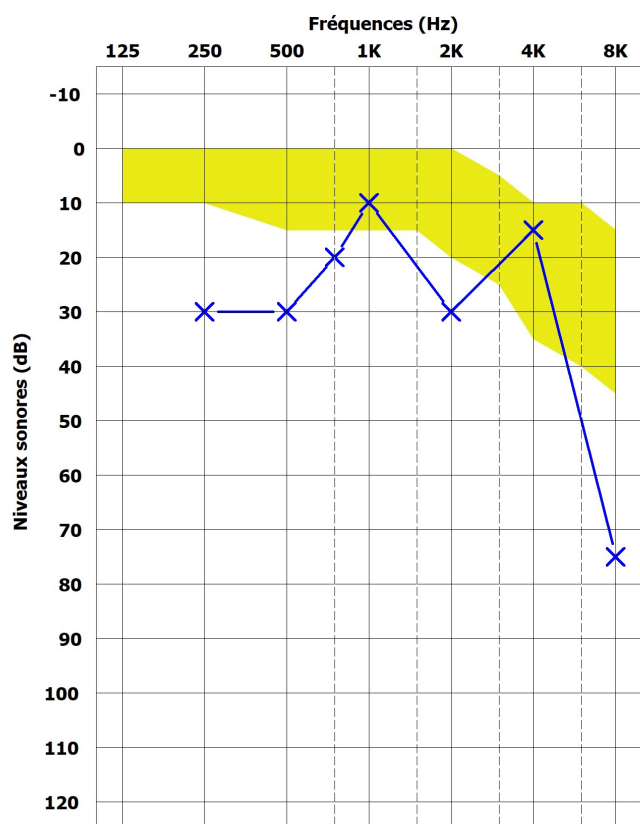

Oreille Gauche

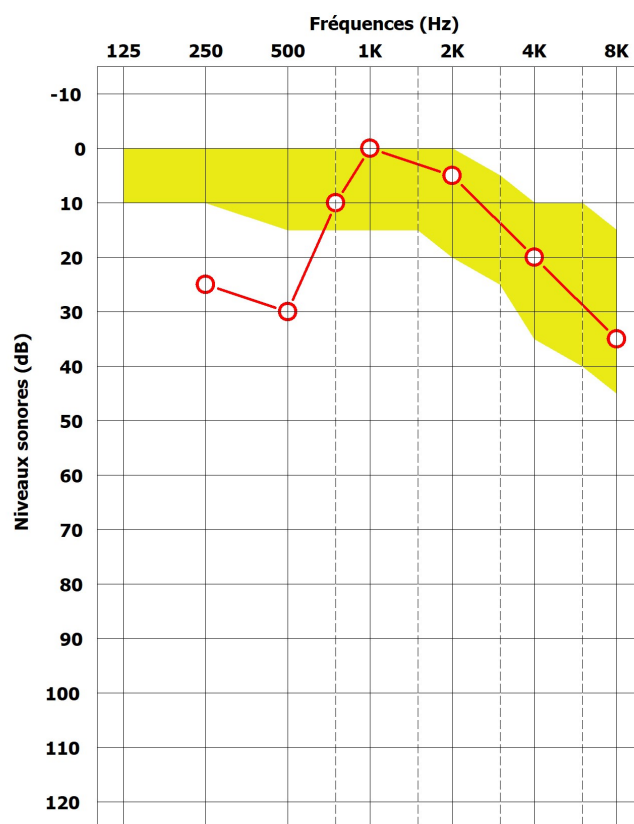

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	20	10		30		15		75
CA Droit		25	30	10	0		5		20		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes