


MEDVIE


Date du test: 17/05/2024 10:50:18
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient	
BILIVOGUI KEKOURA	
Date de naissance	01/01/1998
Age	26
Société	CR18
ID	24051710461723787

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

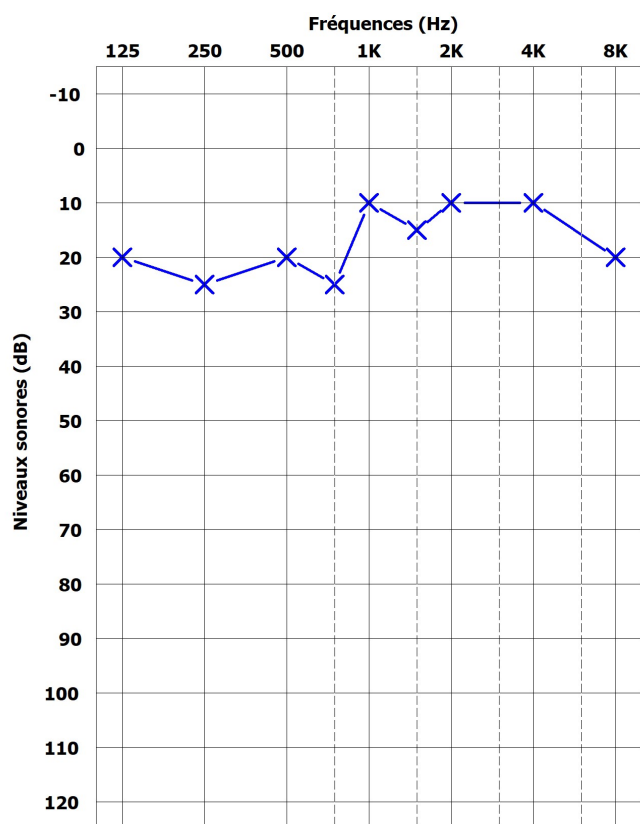

Oreille Gauche

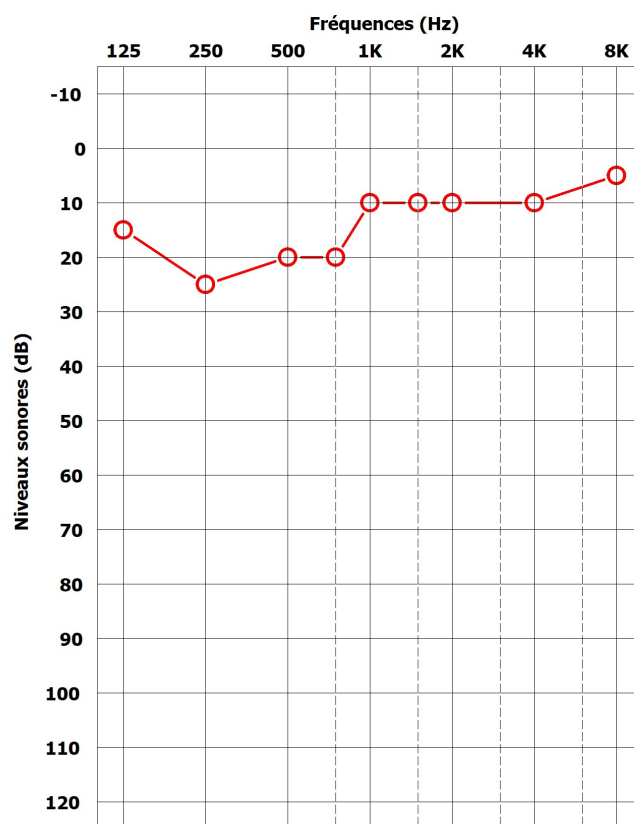

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	25	20	25	10	15	10		10		20
CA Droit	15	25	20	20	10	10	10		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes