


MEDVIE

Date du test: 14/04/2025 12:53:42
Durée: 3mn 35s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	XIAO TAIZHANG
Date de naissance	28/01/1977
Age	48
Société	CR18
ID	25041412393076693

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

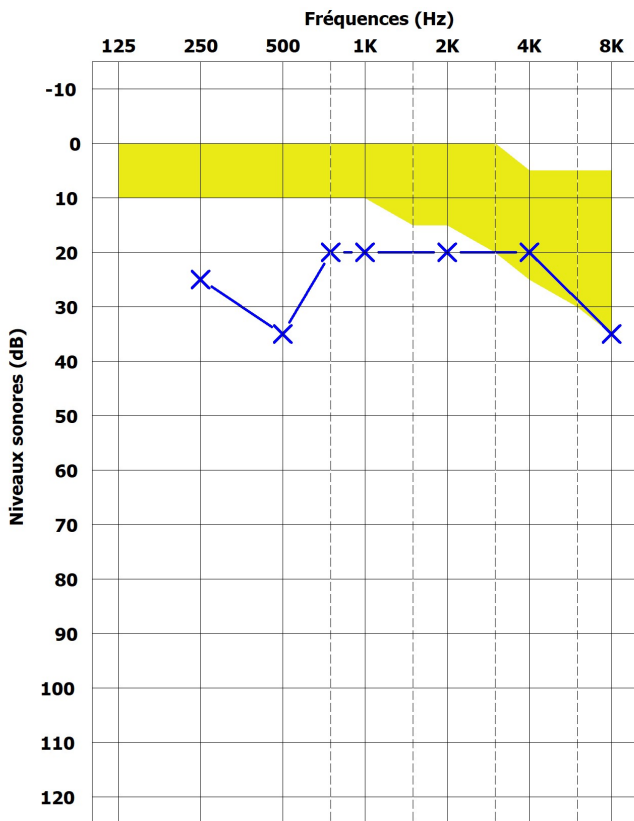

Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	35	20	20		20		20		35
CA Droit		50	30	30	20		20		20		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes