

MEDVIE

Date du test: 14/05/2024 14:22:26

Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

Données Patient

KEÏTA N'FALY

Date de naissance 01/01/1987

Age 37

Société CR18


ID 24051414184238134

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

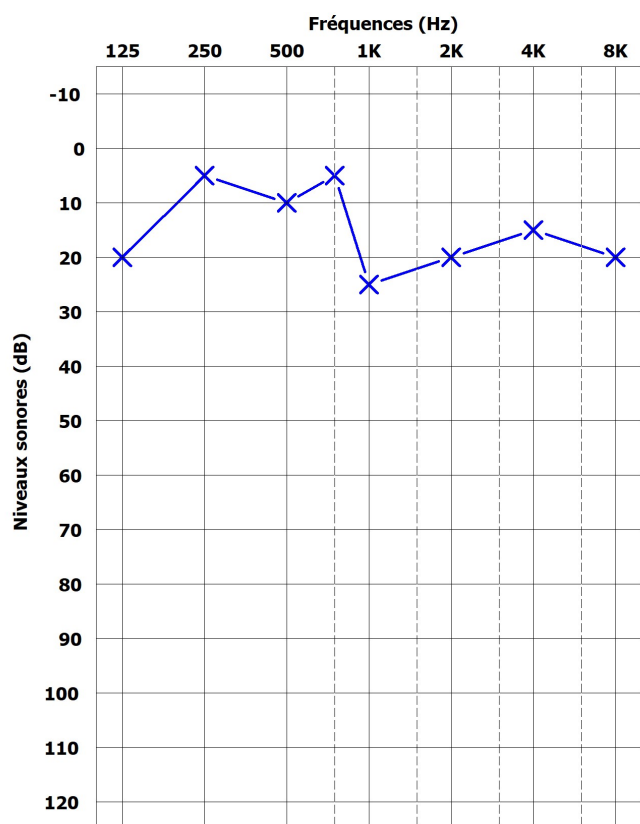

Oreille Gauche

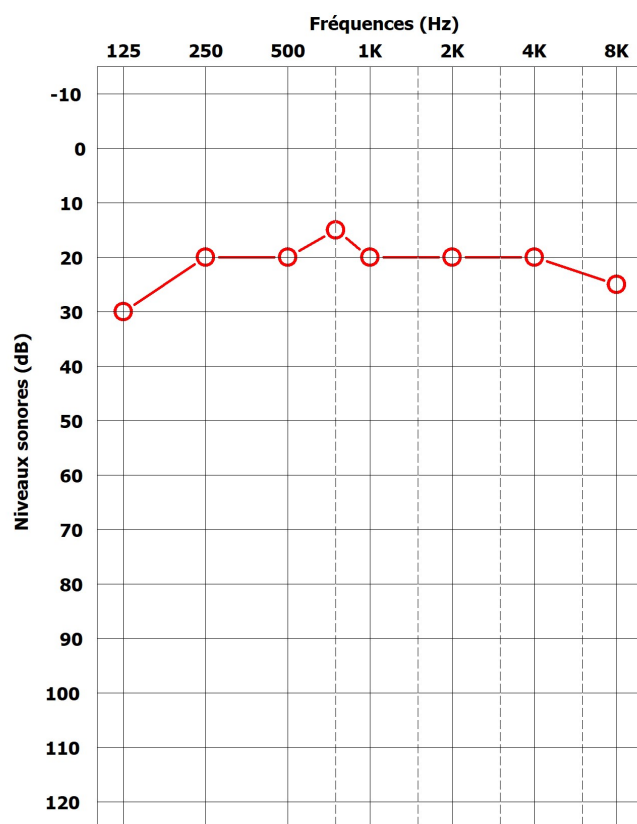

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	5	10	5	25		20		15		20
CA Droit	30	20	20	15	20		20		20		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes