


MEDVIE


Date du test: 06/08/2025 12:33:37
Durée: 3mn 43s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
LAMAH SENY ELISABETH	
Date de naissance	01/01/1993
Age	32
Société	CR18
ID	25080611370305988

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

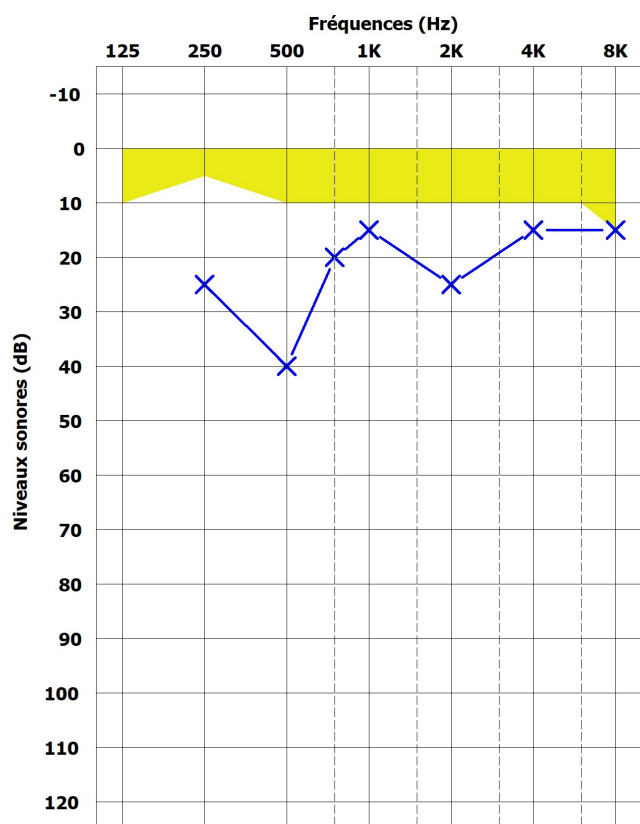

Oreille Gauche

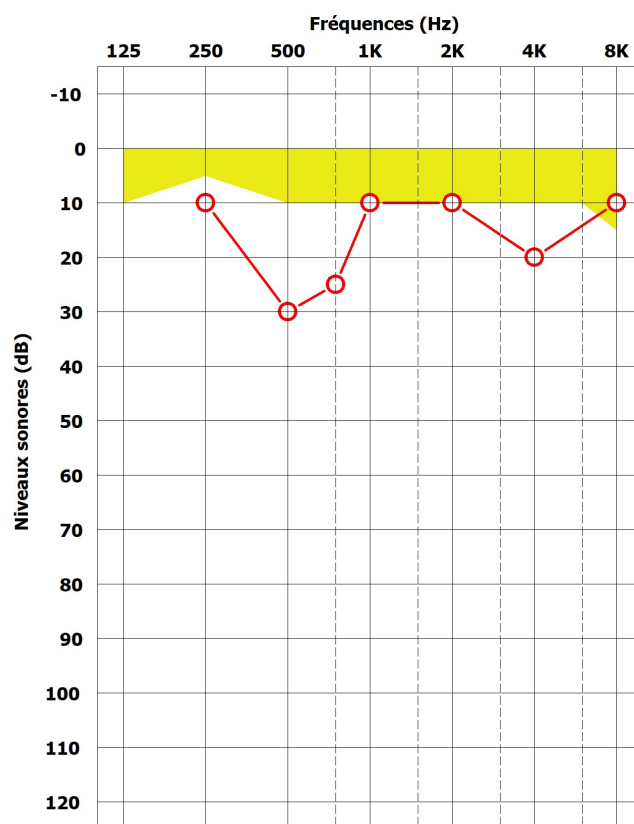

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	40	20	15		25		15		15
CA Droit		10	30	25	10		10		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes