



| Données Patient   |                   | TRAORE FASSOU |
|-------------------|-------------------|---------------|
| Date de naissance | 01/01/1984        |               |
| Age               | 40                |               |
| Société           | CR18              |               |
| ID                | 24050510171366160 |               |

Date du test: 05/05/2024 10:21:31  
 Durée: -- mn -- s  
 Type test Manuel  
 Continu

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

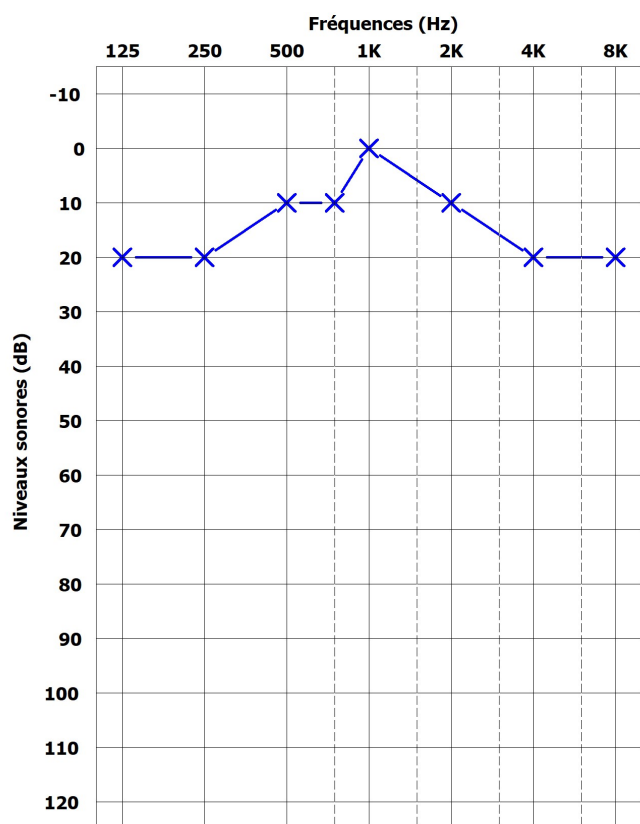

Oreille Gauche

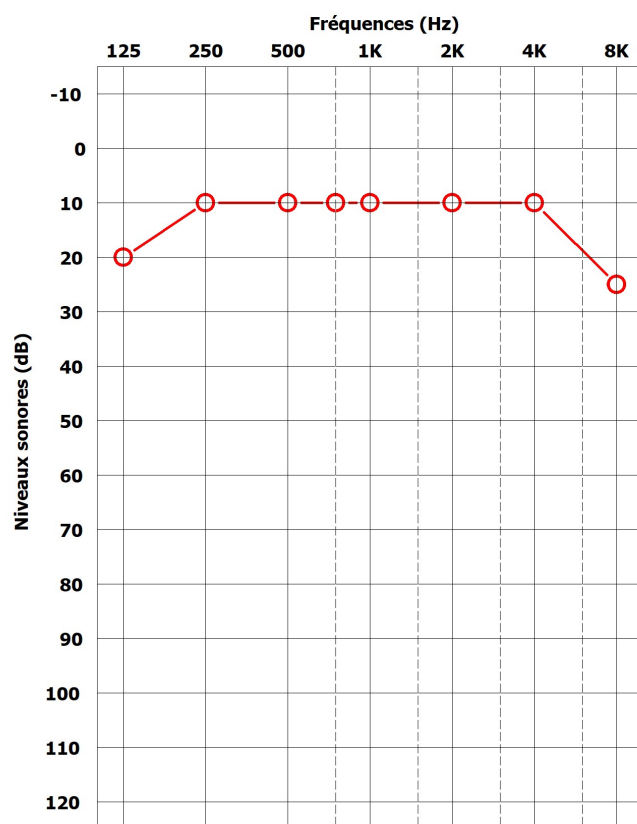

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 20  | 20  | 10  | 10  | 0  |     | 10 |    | 20 |    | 20 |
| CA Droit  | 20  | 10  | 10  | 10  | 10 |     | 10 |    | 10 |    | 25 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 10,0 dB | --- |
| CA Droit        | 10,0 dB | --- |

Notes