


MEDVIE


Date du test: 04/07/2025 17:35:19  
Durée: 4mn 49s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   | BO DANG |
|-------------------|-------------------|---------|
| Date de naissance | 07/01/1992        |         |
| Age               | 33                |         |
| Société           | CR18              |         |
| ID                | 25070417254824591 |         |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

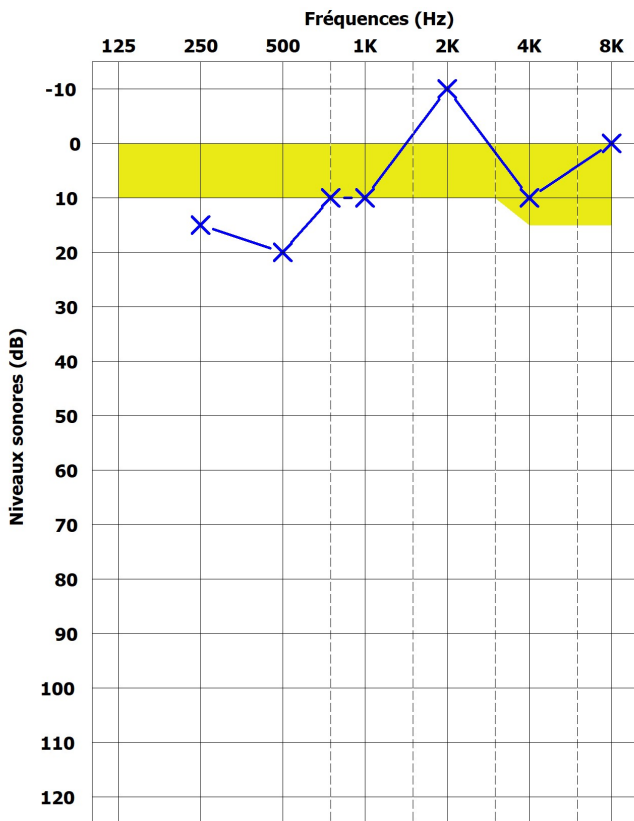

Oreille Gauche

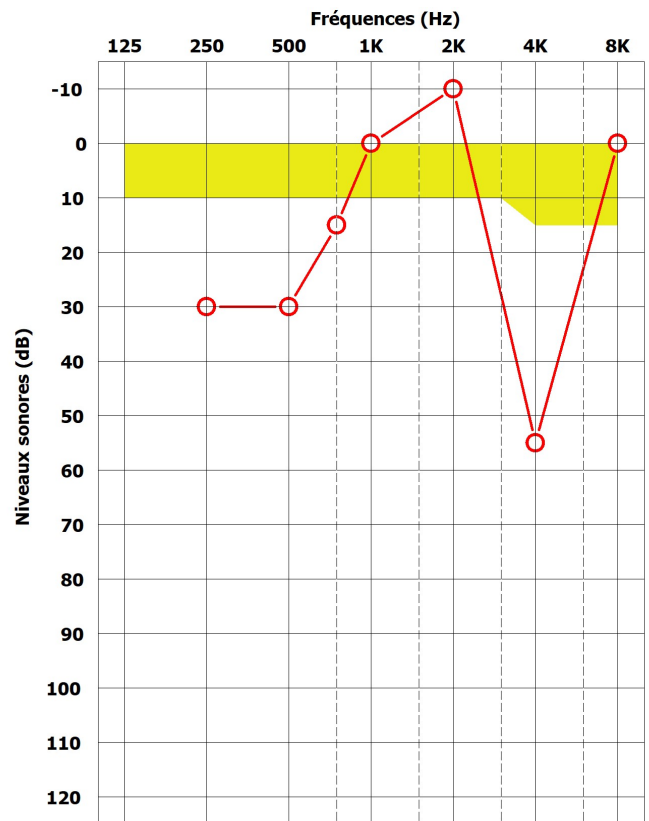

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k  | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 15  | 20  | 10  | 10 |     | -10 |    | 10 |    | 0  |
| CA Droit  |     | 30  | 30  | 15  | 0  |     | -10 |    | 55 |    | 0  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 7,5 dB  | --- |
| CA Droit        | 18,8 dB | --- |

Notes