

MEDVIE

Date du test: 09/04/2025 14:15:39
Durée: 3mn 54s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient

NI BAIQIANG

Date de naissance: 21/11/1979
Age: 45
Société: CR18
ID: 25040914135076040

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

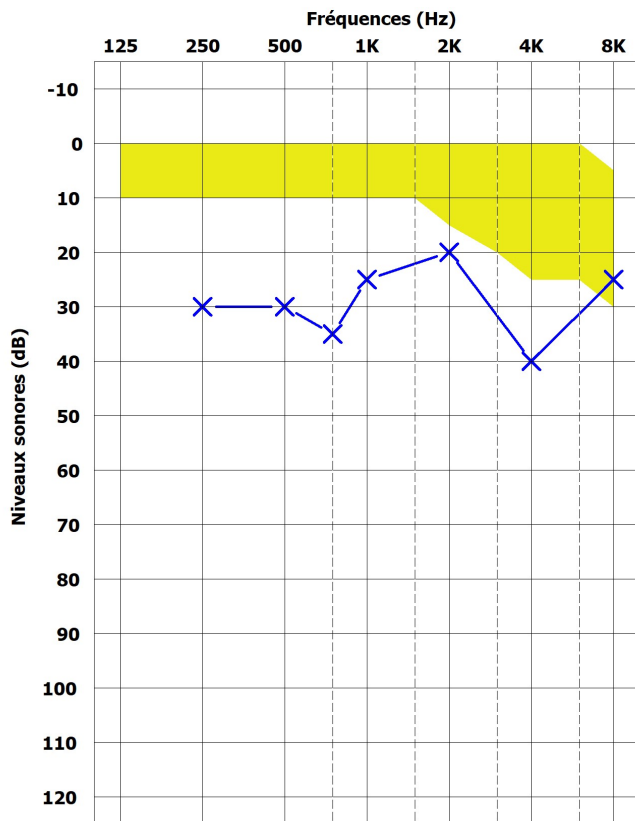

Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	35	25		20		40		25
CA Droit		35	35	25	20		25		35		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes