


MEDVIE


Date du test: 28/05/2024 17:39:58
Durée: 9mn 49s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	CAMARA BAKARY
Date de naissance	01/01/1964
Age	60
Société	CR18
ID	24052817371040877

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

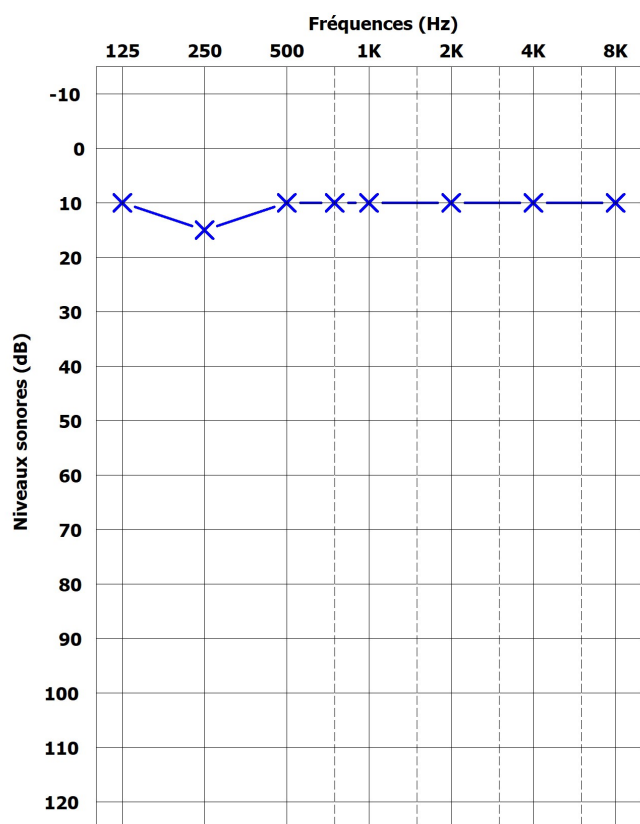

Oreille Gauche

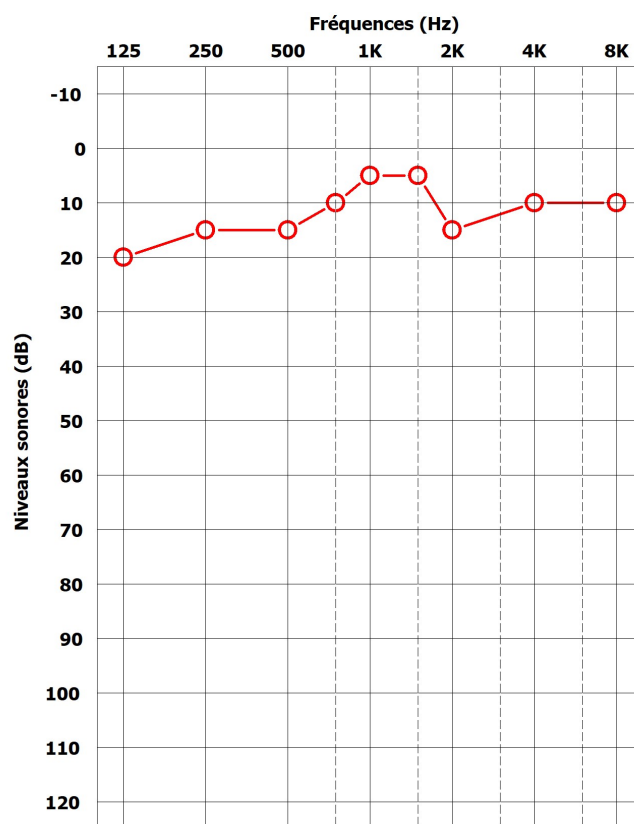

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	15	10	10	10		10		10		10
CA Droit	20	15	15	10	5	5	15		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes