


MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 20:19:27

Durée: 6mn 23s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

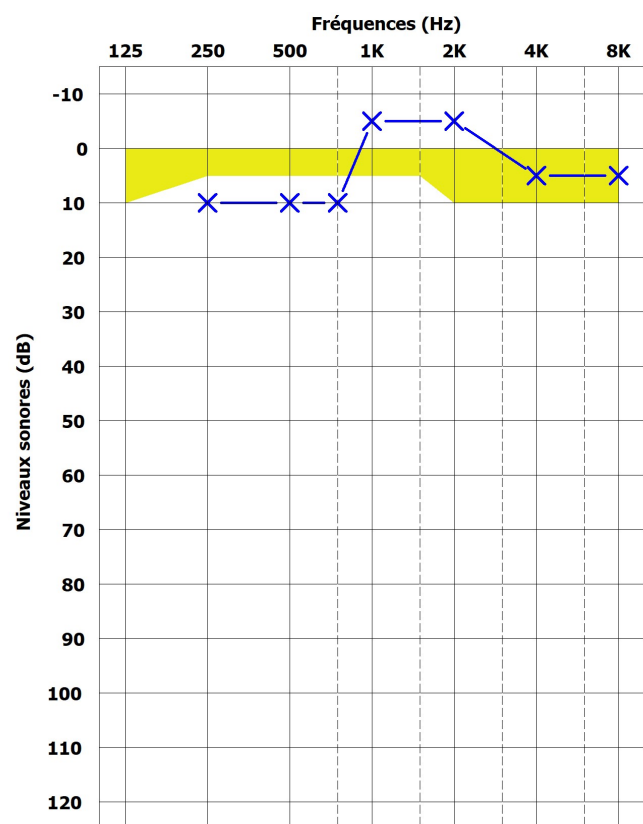

Oreille Gauche

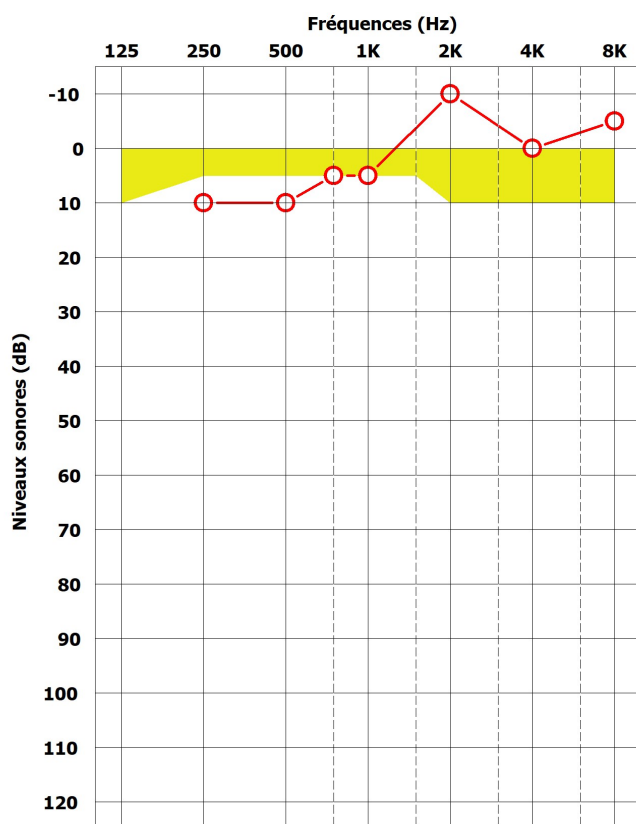

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k  | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 10  | 10  | 10  | -5 |     | -5  |    | 5  |    | 5  |
| CA Droit  |     | 10  | 10  | 5   | 5  |     | -10 |    | 0  |    | -5 |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 1,3 dB | --- |
| CA Droit        | 1,3 dB | --- |

Notes

| Données Patient   | CAMARA SEKOU      |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 30/08/1999        |
| Age               | 25                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 24092919545929053 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |