



Données Patient	CHERIF MOHAMED
Date de naissance	25/06/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24092916251699980

Date du test: 29/09/2024 16:30:20
Durée: 7mn 01s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

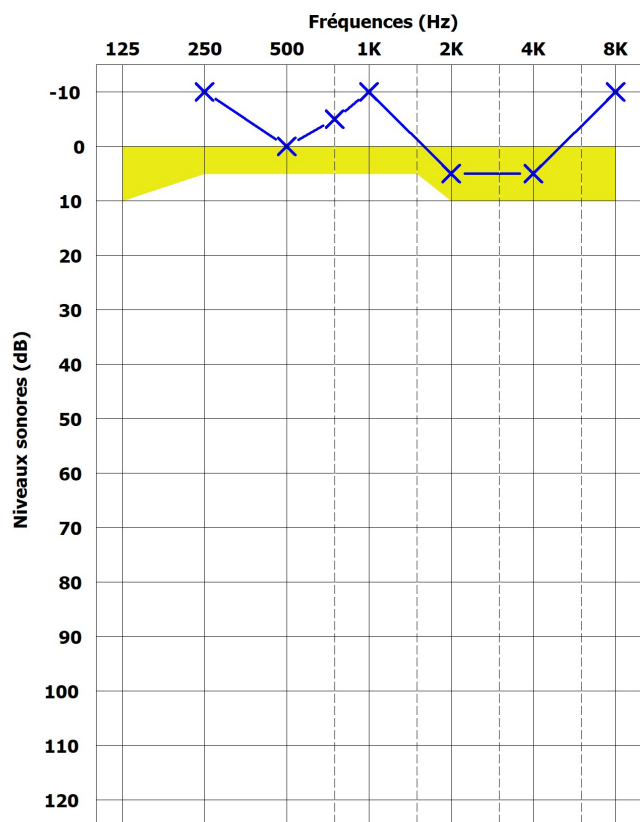

Oreille Gauche

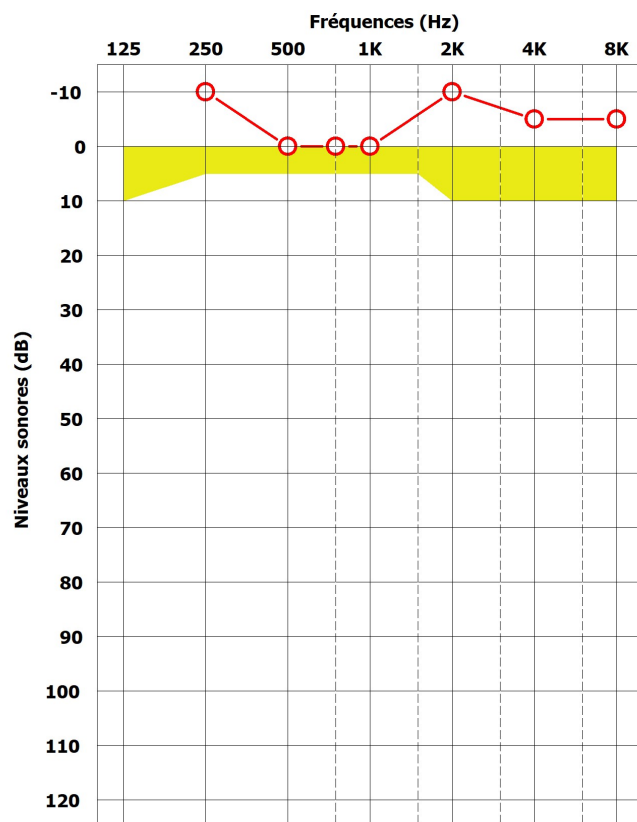

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	0	-5	-10		5		5		-10
CA Droit		-10	0	0	0		-10		-5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	-3,8 dB	---

Notes