

MEDVIE

Date du test: 17/05/2024 11:40:49

Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

 Données Patient **DOUMBOUYA MOHAMED**

Date de naissance 01/01/1998

Age 26

Société CR18


ID 24051711363273340

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

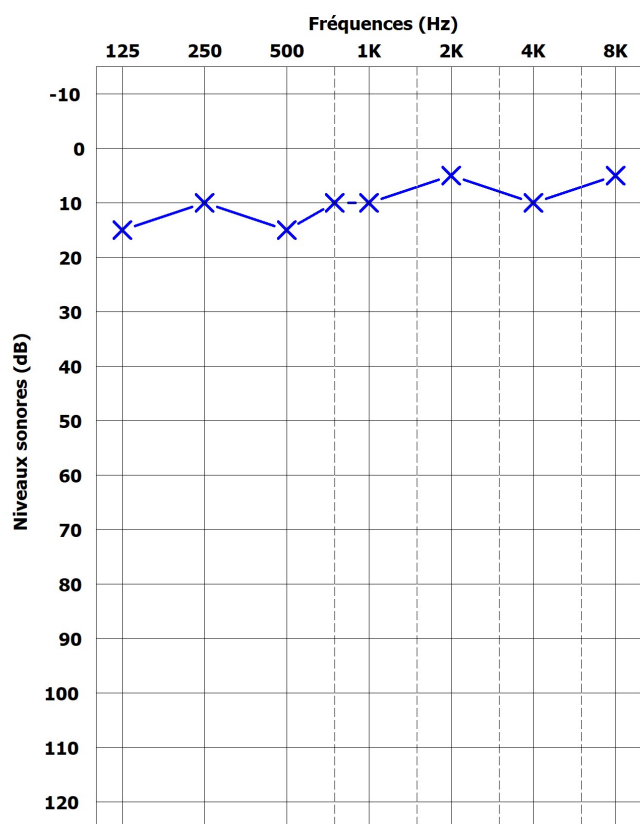

Oreille Gauche

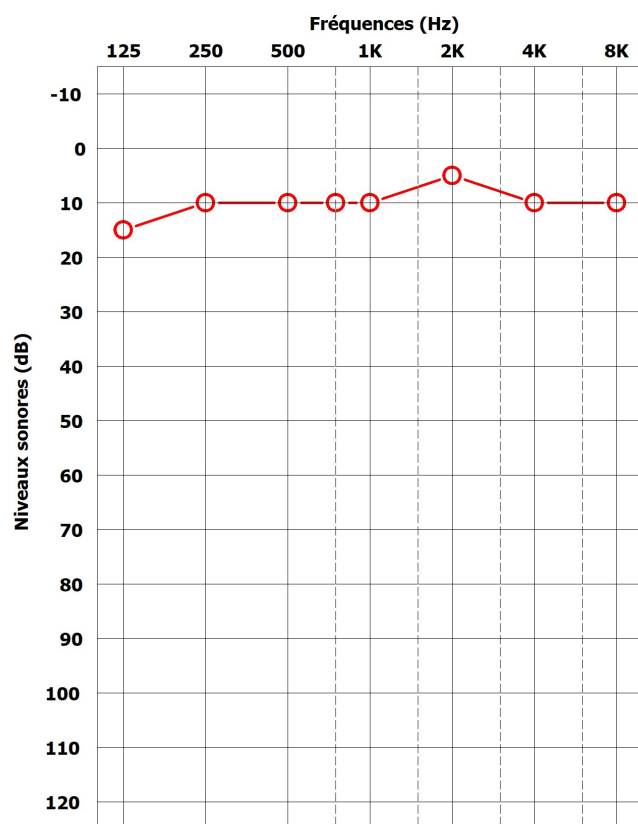

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	15	10	10		5		10		5
CA Droit	15	10	10	10	10		5		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes