

MEDVIE


Date du test: 05/03/2025 17:00:08

Durée: 5mn 51s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KONATE MAMADY
Date de naissance	02/02/2002
Age	23
Société	CR18
ID	25030516064874734

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

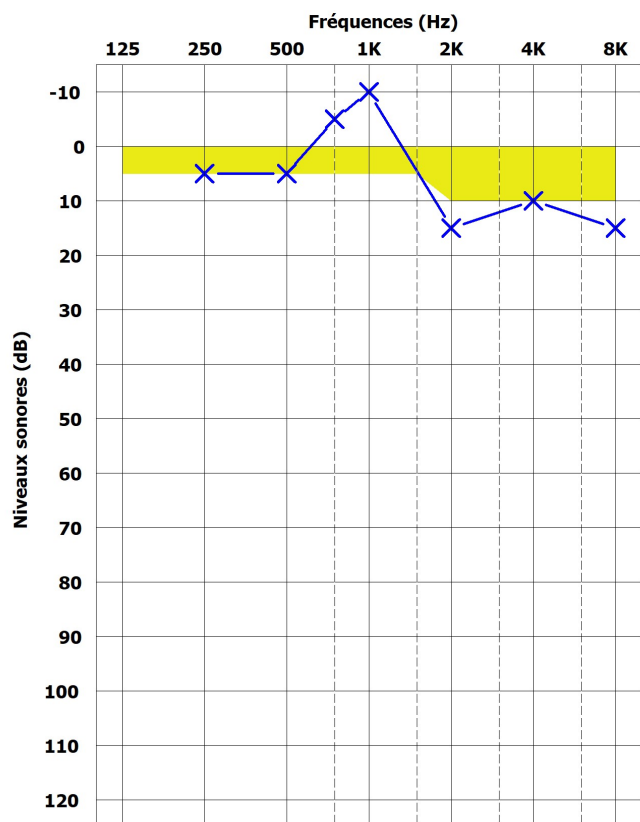

Oreille Gauche

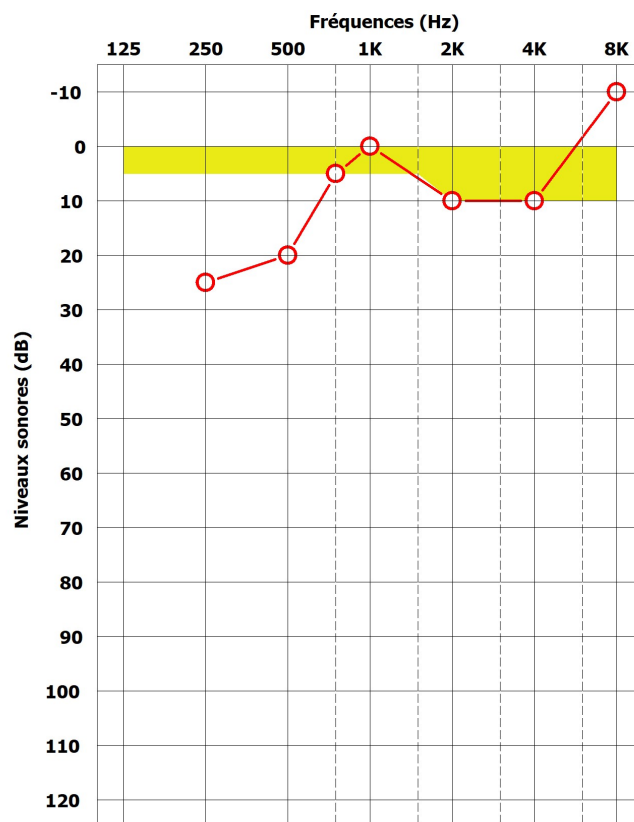

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	-5	-10		15		10		15
CA Droit		25	20	5	0		10		10		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes