

Données Patient


KANTE DIALLO

Date de naissance 31/01/1991
Age 33
Société CR18
ID 24050217222000115


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 02/05/2024 17:38:08
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

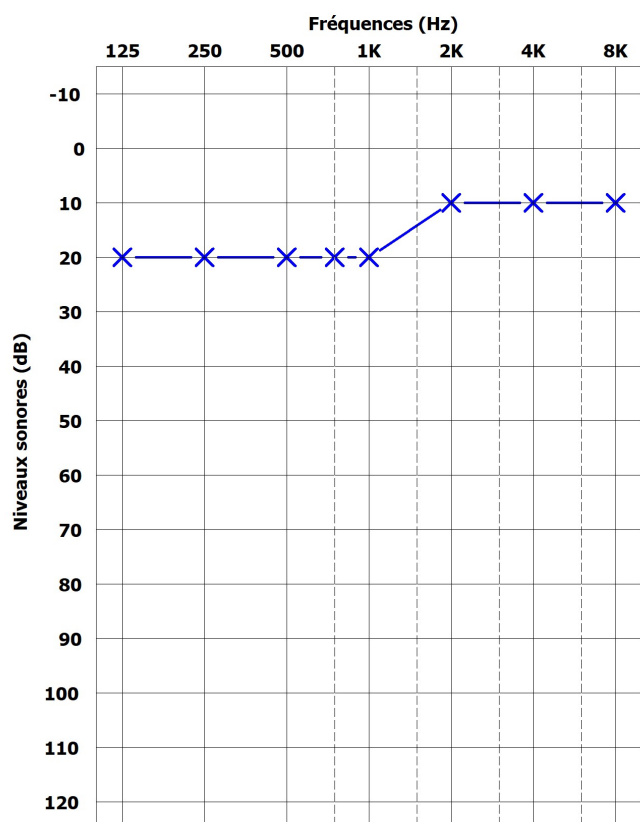

Oreille Gauche

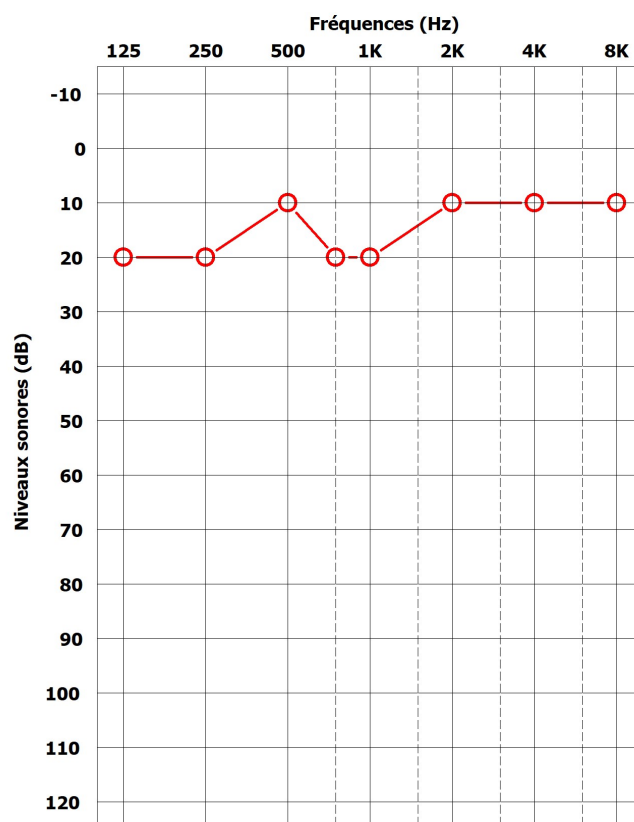

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	20	20	20		10		10		10
CA Droit	20	20	10	20	20		10		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes