


MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 20:13:04
Durée: 5mn 39s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA BAKARY	
Date de naissance	22/03/1989
Age	35
Société	CR18
ID	24092919540175122

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

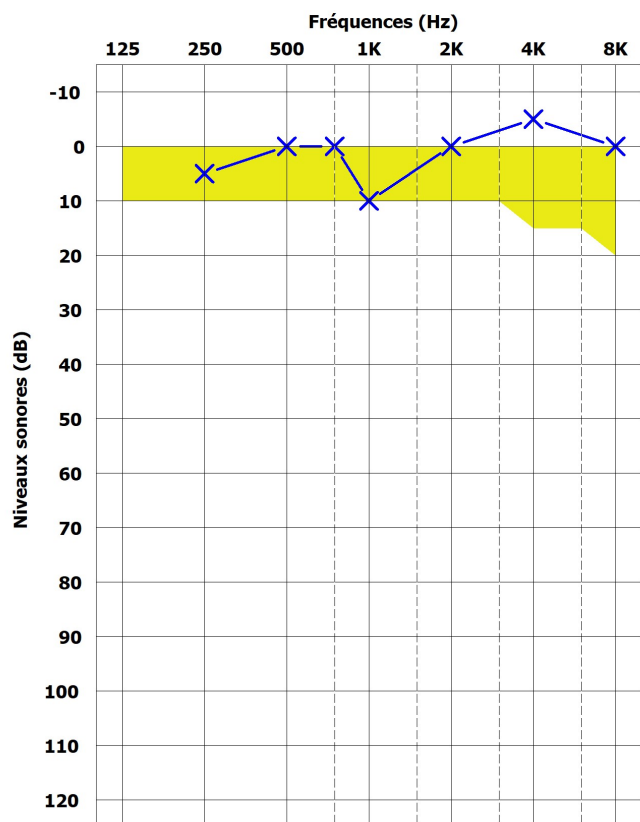

Oreille Gauche

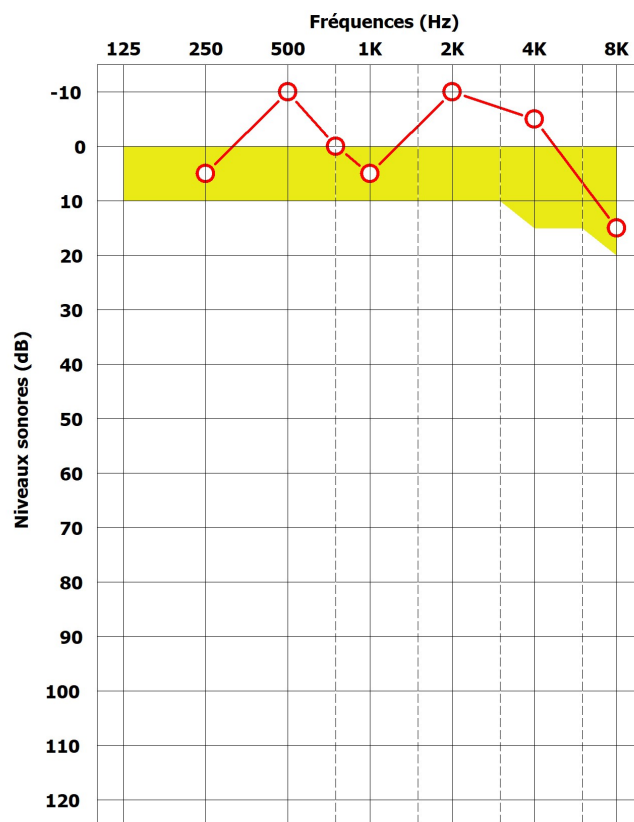

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	0	0	10		0		-5		0
CA Droit		5	-10	0	5		-10		-5		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	1,3 dB	---
CA Droit	-5,0 dB	---

Notes