


MEDVIE


Date du test: 29/03/2024 15:52:49
Durée: 14mn 03s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAORO ZOUMANA	
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	CR18
ID	24032915494016893

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

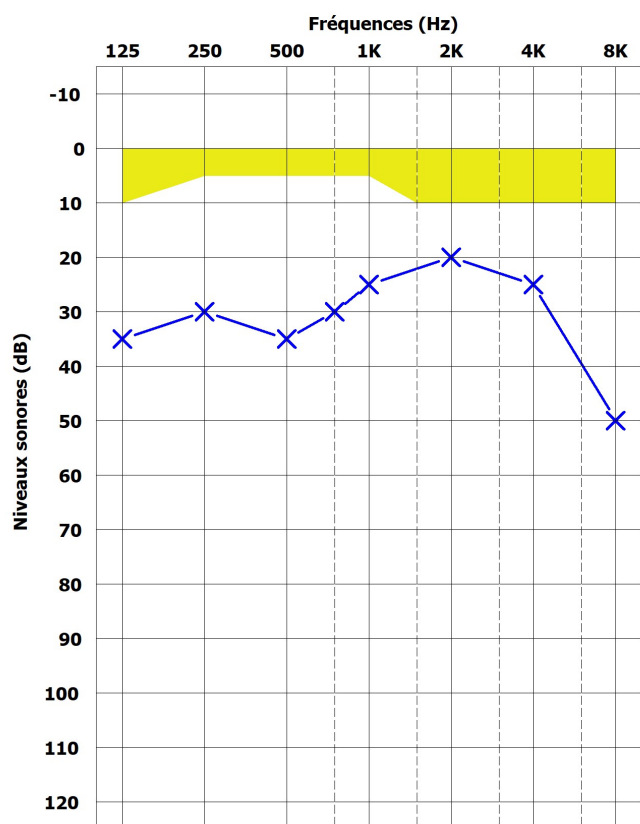

Oreille Gauche

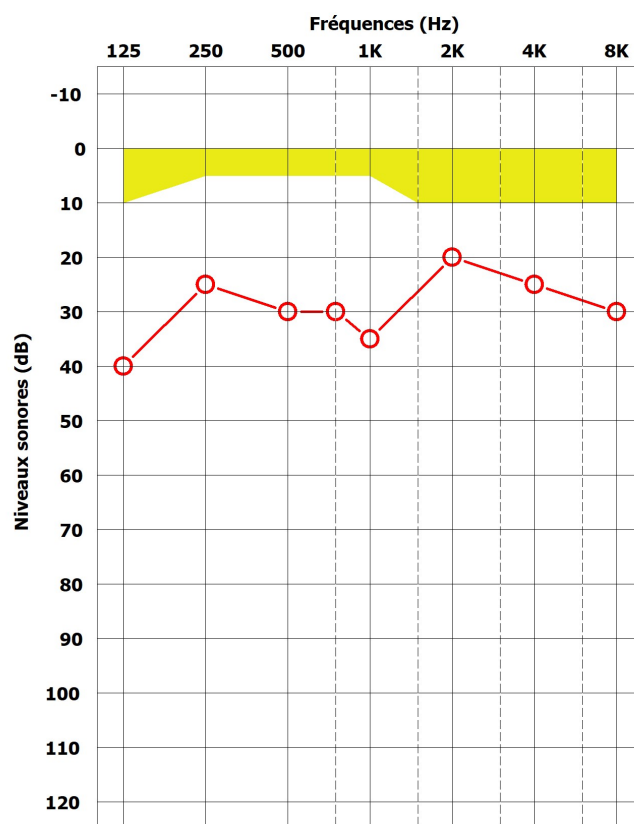

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	30	35	30	25		20		25		50
CA Droit	40	25	30	30	35		20		25		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	27,5 dB	---

Notes