


MEDVIE


Date du test: 29/07/2025 15:01:53
Durée: 3mn 08s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
FOFANA ABDOULAYE	
Date de naissance	01/01/1972
Age	53
Société	CR18
ID	25072914593874122

Audiomètre	
Type:	Audio 800M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

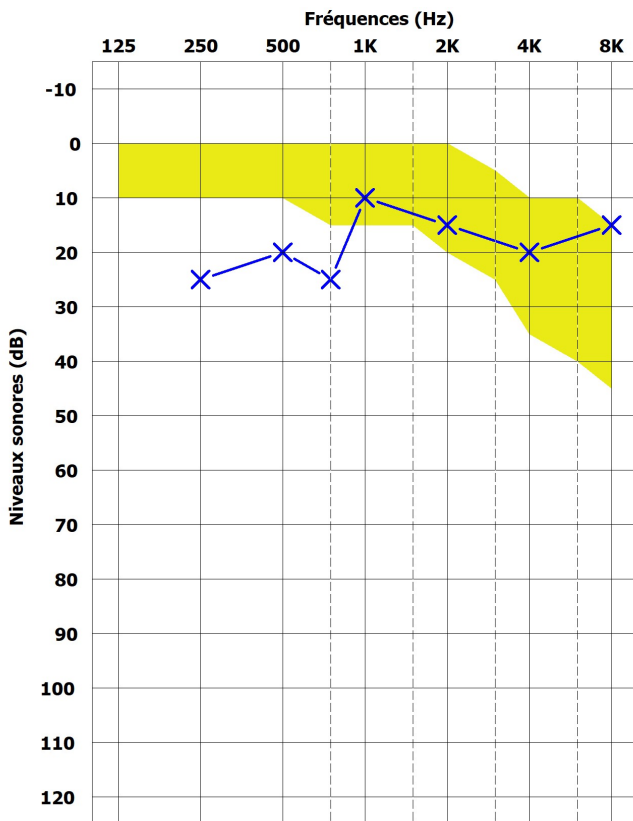

Oreille Gauche

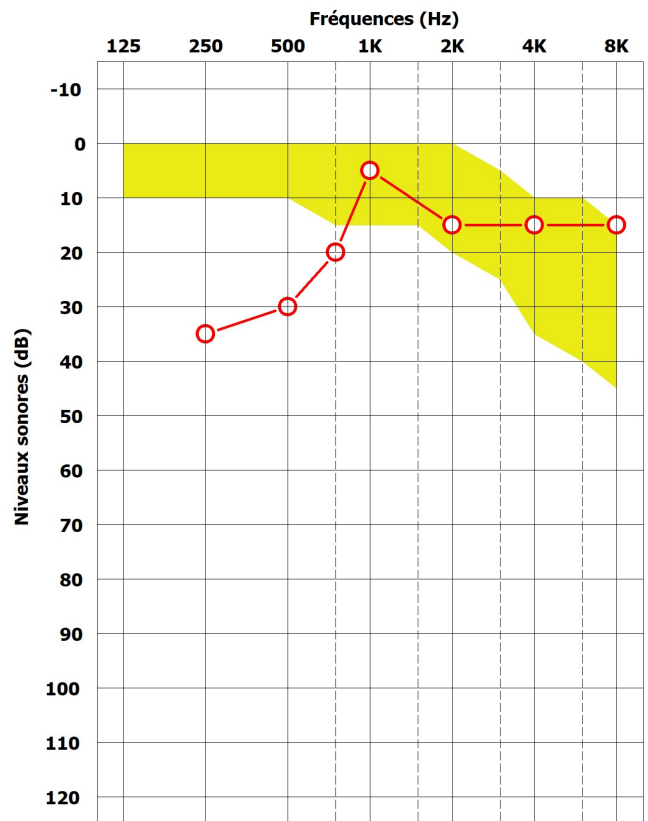

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	25	10		15		20		15
CA Droit		35	30	20	5		15		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes