


MEDVIE


Date du test: 24/05/2024 11:36:40
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		CAMARA KEMO
Date de naissance	01/01/1989	
Age	35	
Société	CR18	
ID	24052411320811734	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

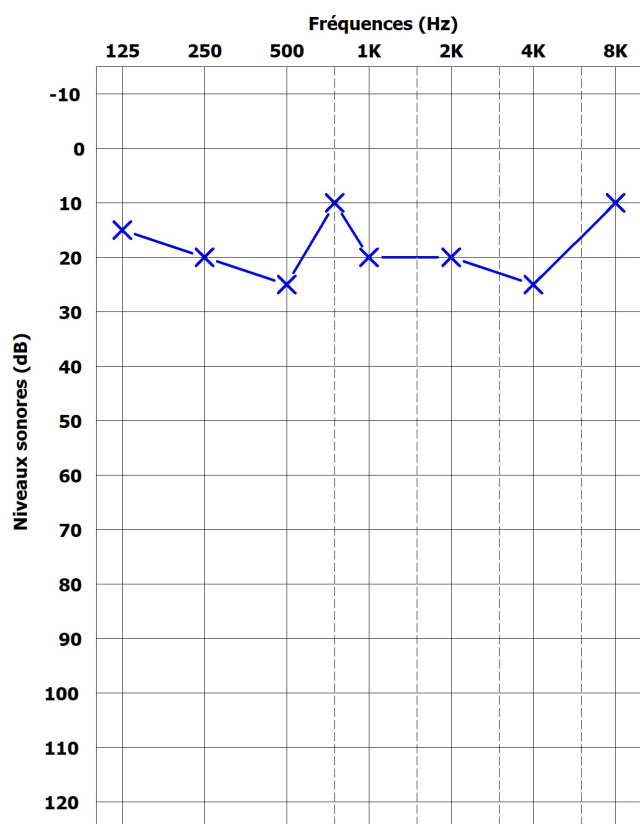

Oreille Gauche

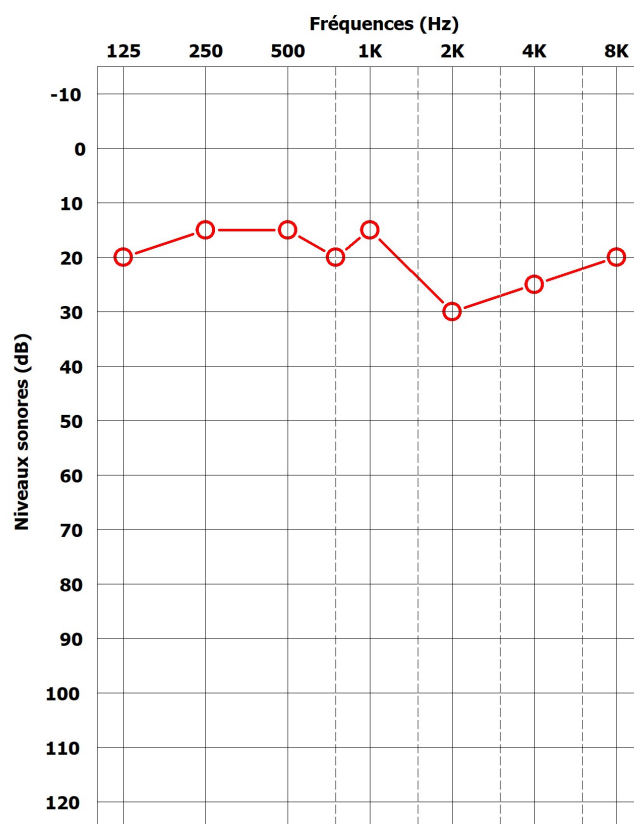

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	20	25	10	20		20		25		10
CA Droit	20	15	15	20	15		30		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes