


MEDVIE


Date du test: 31/05/2024 11:27:30
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient		KEÏTA N'FALY
Date de naissance	01/01/1994	
Age	30	
Société	CR18	
ID	24053111240771713	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

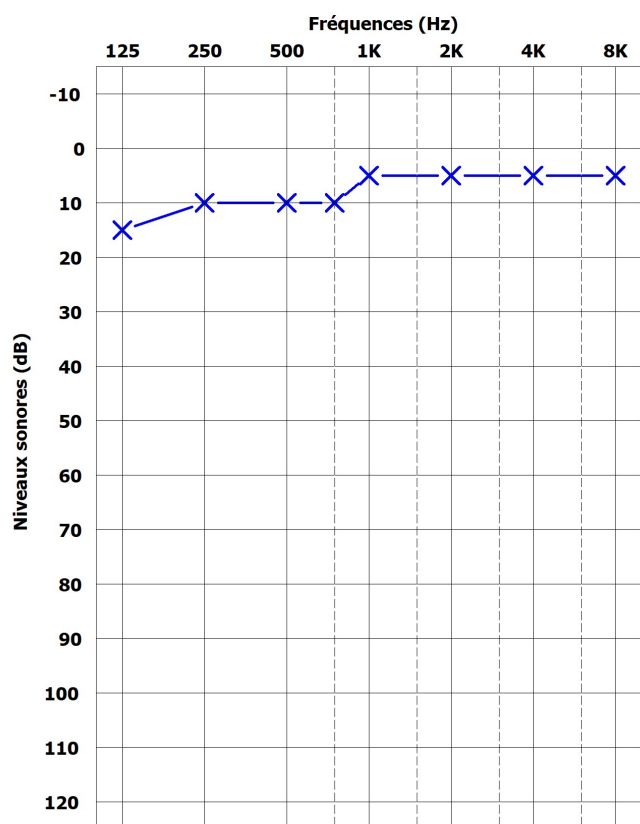

Oreille Gauche

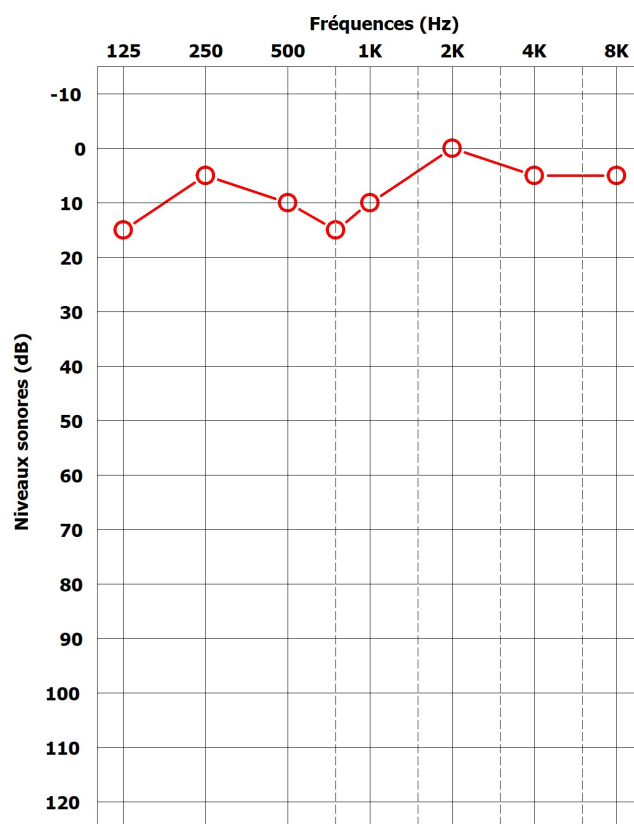

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	10	10	5		5		5		5
CA Droit	15	5	10	15	10		0		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes