

Données Patient

TRAORE SEKOU

Date de naissance 06/08/2002
Age 22
Société CR18
ID 24102313235864103


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021


Date du test: 23/10/2024 13:26:04

Durée: 4mn 42s

Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

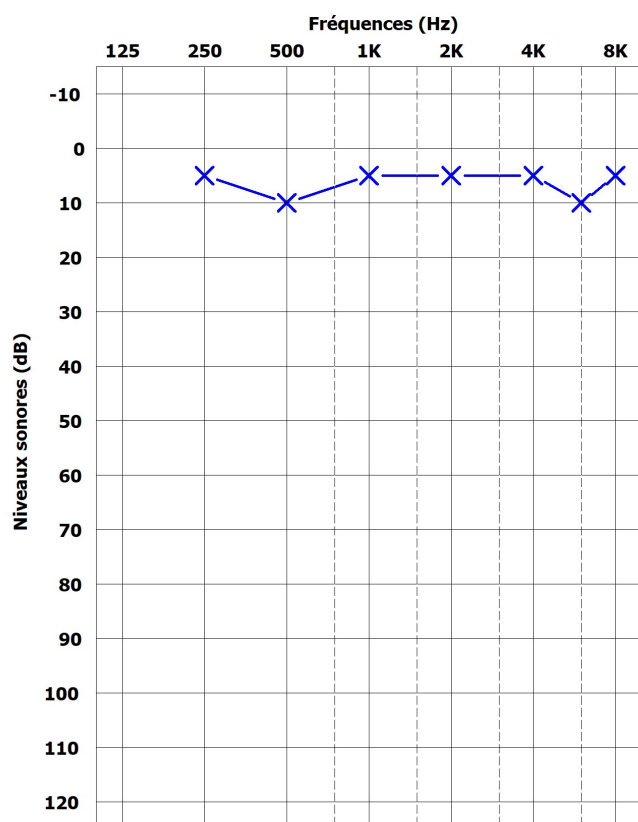

Oreille Gauche

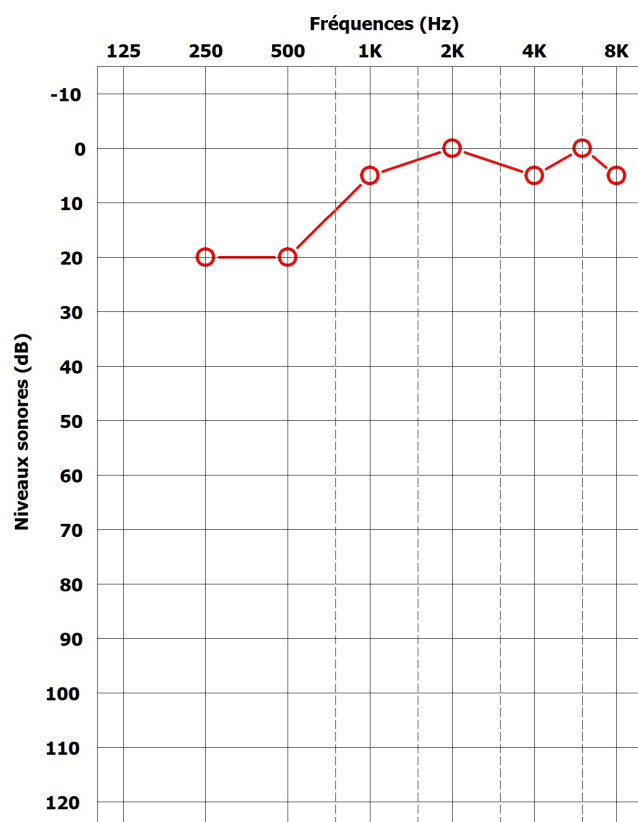

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10		5		5		5	10	5
CA Droit		20	20		5		0		5	0	5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	---	---
CA Droit	---	---

Notes