


MEDVIE


Date du test: 15/04/2024 16:18:56

Durée: 8mn 02s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

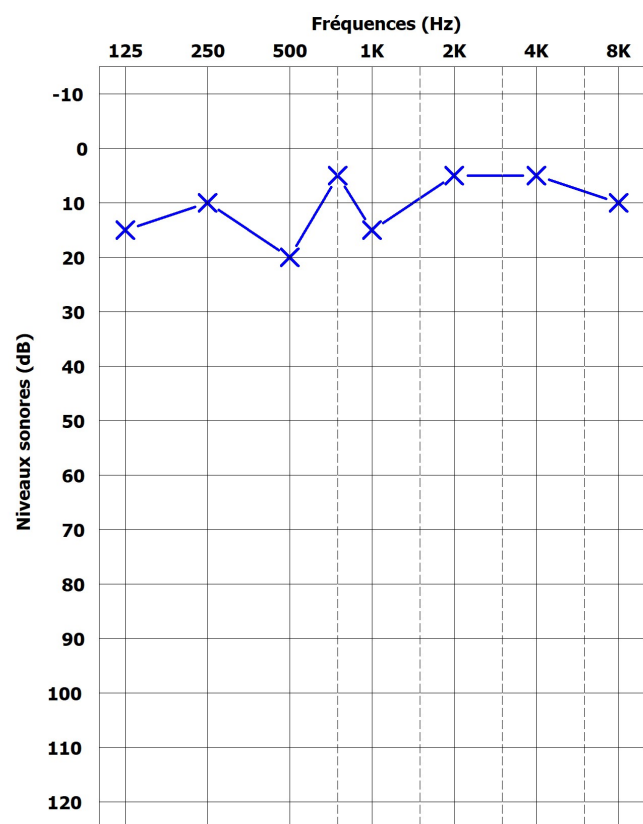

Oreille Gauche

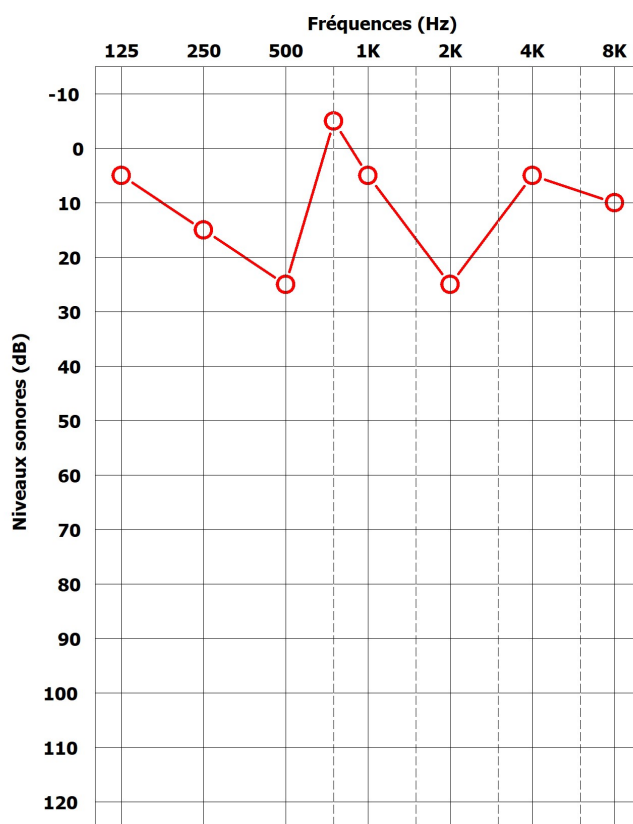

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	20	5	15		5		5		10
CA Droit	5	15	25	-5	5		25		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient	SQUARE MAMADY
Date de naissance	01/01/1984
Age	40
Société	CR18
ID	24041516155190861

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021