


MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 13:26:11
Durée: 6mn 29s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA MOHAMED	
Date de naissance	03/03/1997
Age	28
Société	CR18
ID	25031512534473244

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

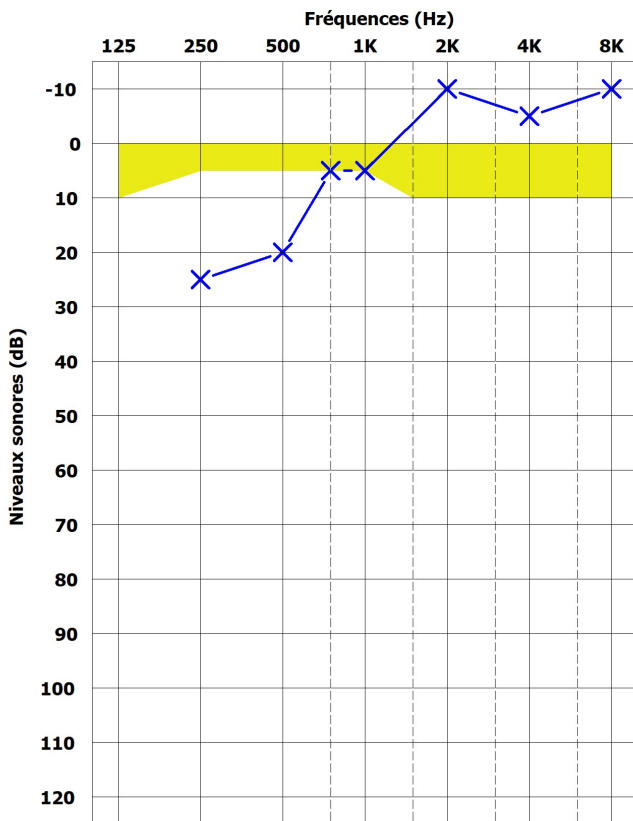

Oreille Gauche

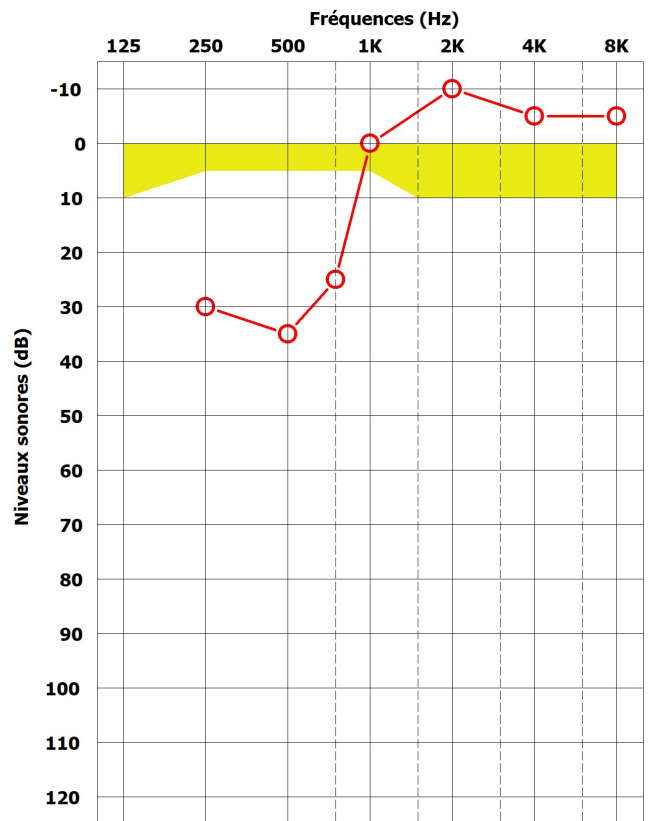

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	5	5		-10		-5		-10
CA Droit		30	35	25	0		-10		-5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes