


MEDVIE


Date du test: 19/08/2025 11:30:27
Durée: 5mn 17s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA MOHAMED	
Date de naissance	01/01/1999
Age	26
Société	CR18
ID	25081911234122587

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

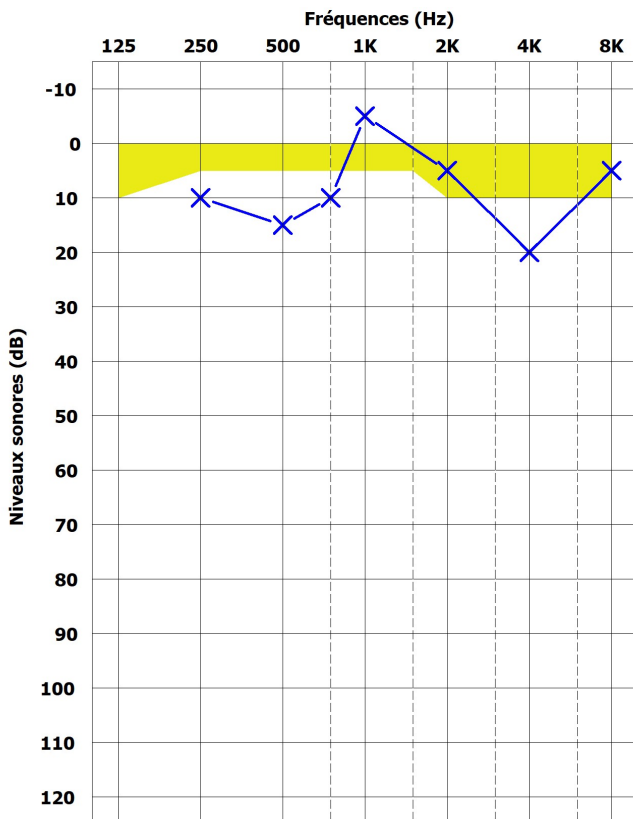

Oreille Gauche

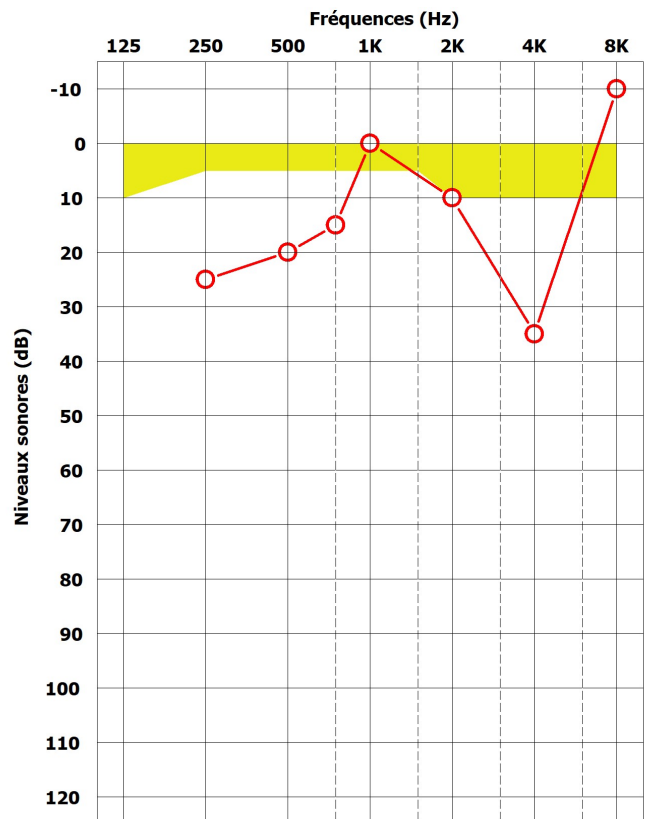

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	10	-5		5		20		5
CA Droit		25	20	15	0		10		35		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes