

Données Patient

DIABY MAMADY

Date de naissance

01/01/1993

Age

31

Société

CR18

ID

24050416125858598

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :


30/11/2021

Date du test: 04/05/2024 16:17:34


Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

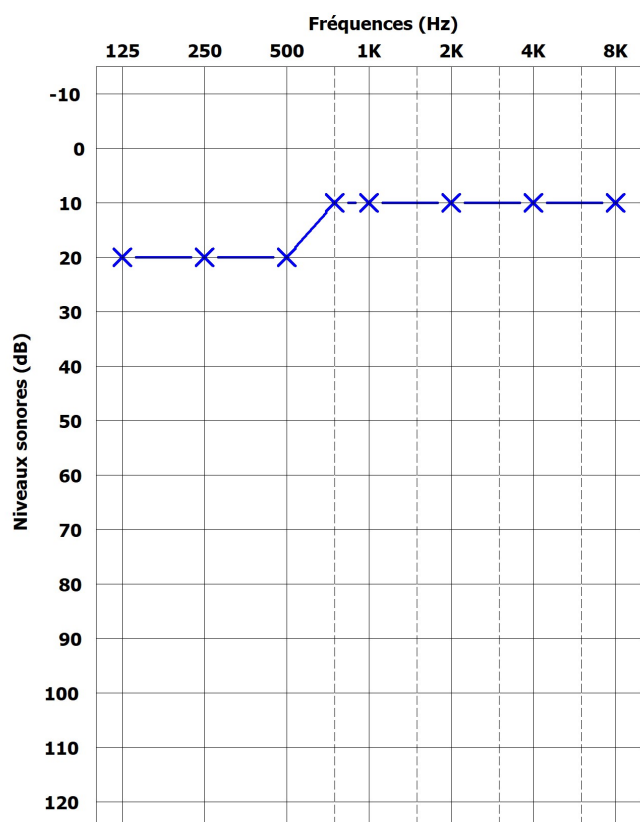

Oreille Gauche

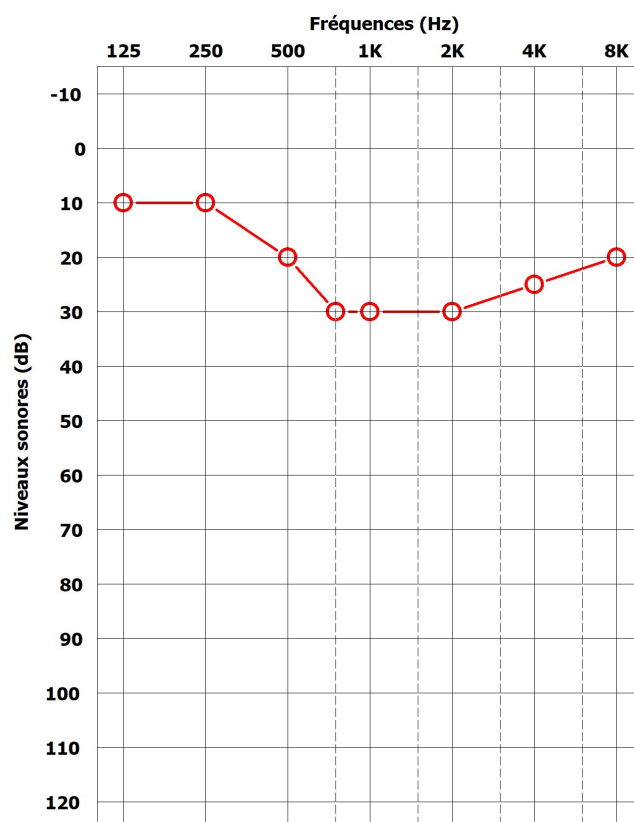

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	20	10	10		10		10		10
CA Droit	10	10	20	30	30		30		25		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes