

MEDVIE


Date du test: 28/03/2024 17:17:01

Durée: 9mn 27s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TRAORE SEKOU
Date de naissance	01/01/1984
Age	40
Société	CR18
ID	24032817141481811

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

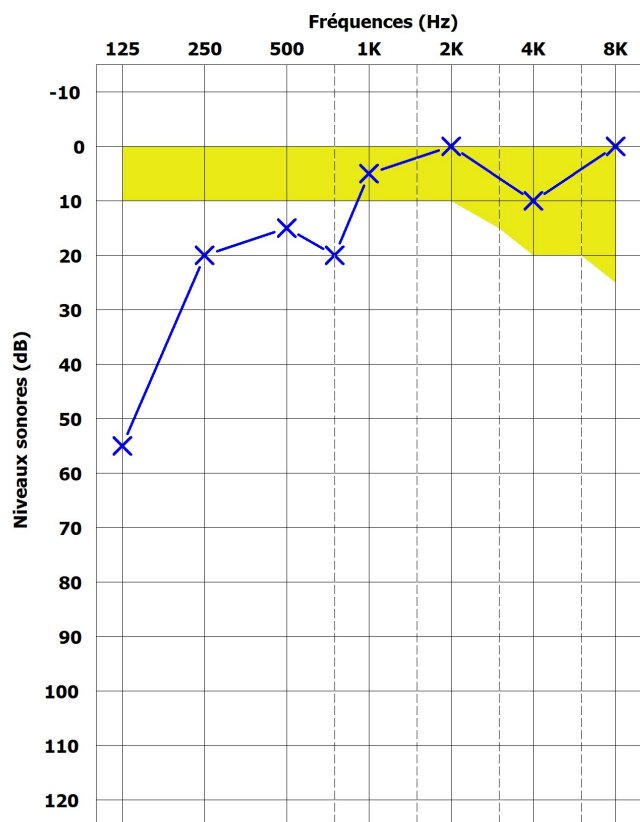

Oreille Gauche

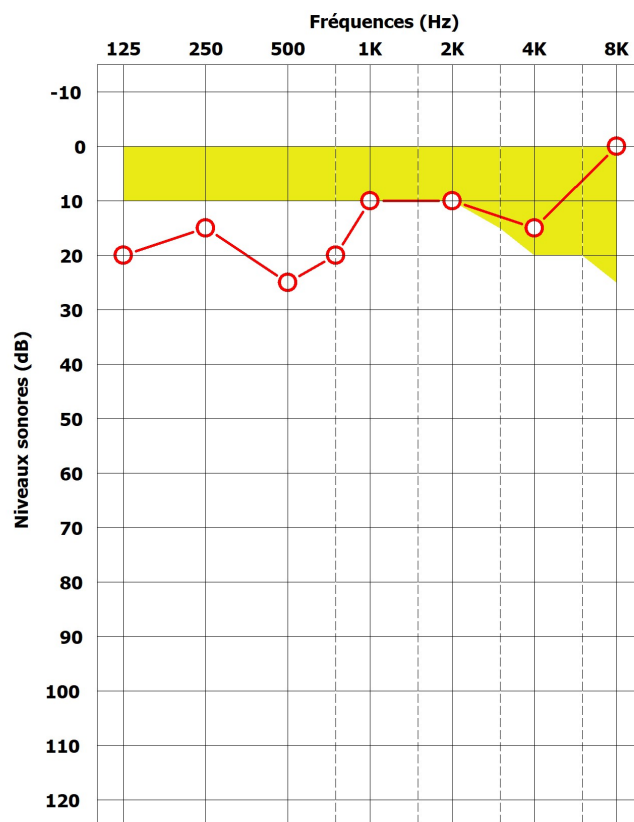

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	55	20	15	20	5		0		10		0
CA Droit	20	15	25	20	10		10		15		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes