

MEDVIE BEYLA


Date du test: 02/01/2025 13:52:34

Durée: 5mn 46s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA SEKOU CHEICK	
Date de naissance	25/05/1992
Age	32
Société	CR18
ID	25010213483730212

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

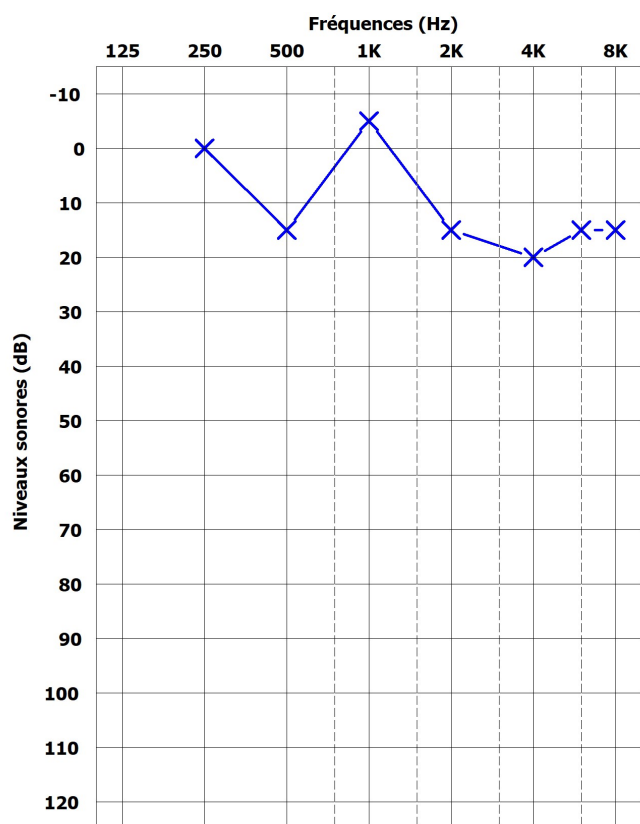

Oreille Gauche

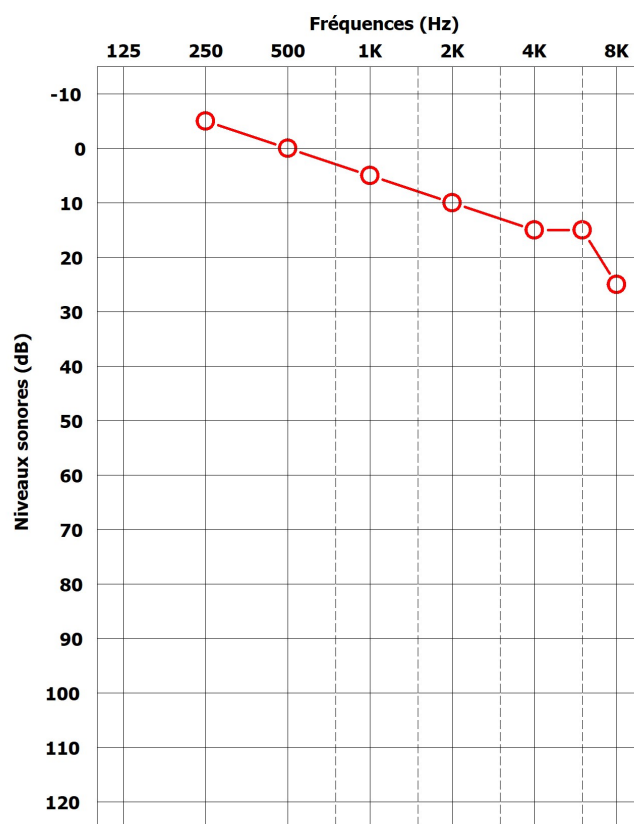

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	15		-5		15		20	15	15
CA Droit		-5	0		5		10		15	15	25

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	-5,0 dB
CA Droit	---	5,0 dB

Notes