



Données Patient		TRAORE SIDIKI
Date de naissance	01/01/1979	
Age	45	
Société	CR18	
ID	24050414261499200	

Date du test: 04/05/2024 14:33:29
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

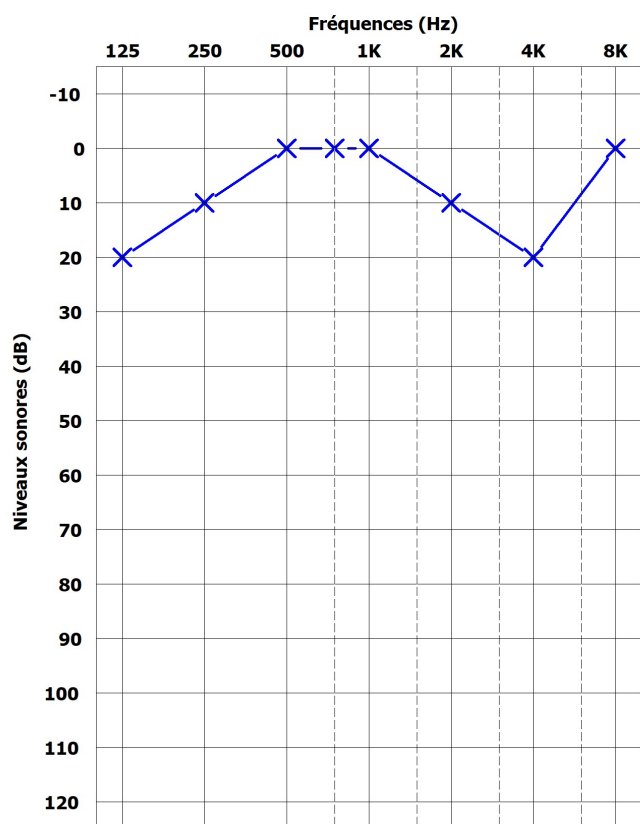

Oreille Gauche

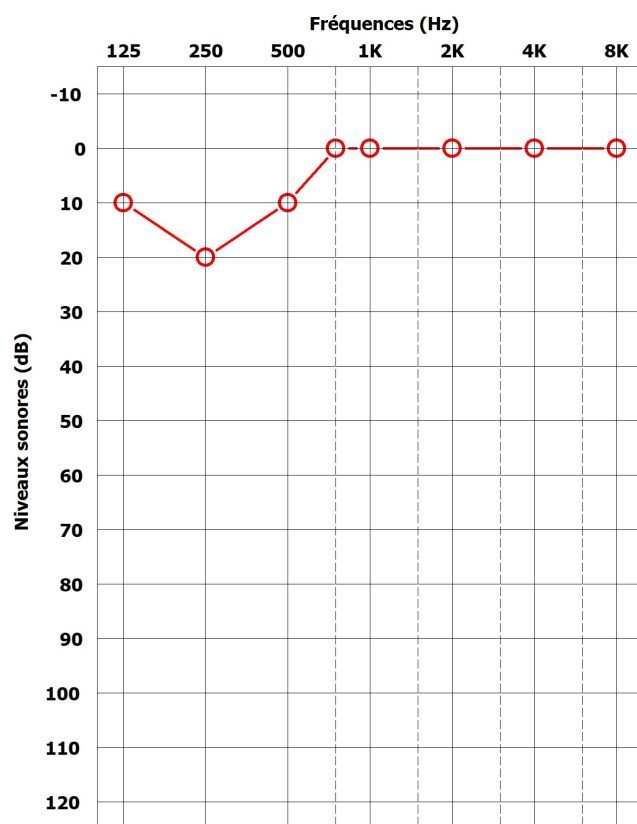

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10	0	0	0		10		20		0
CA Droit	10	20	10	0	0		0		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes