


MEDVIE


Date du test: 04/07/2025 17:13:58
Durée: 3mn 40s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		MA SHUAI
Date de naissance		31/05/1990
Age		35
Société		CR18
ID		25070417104378022

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

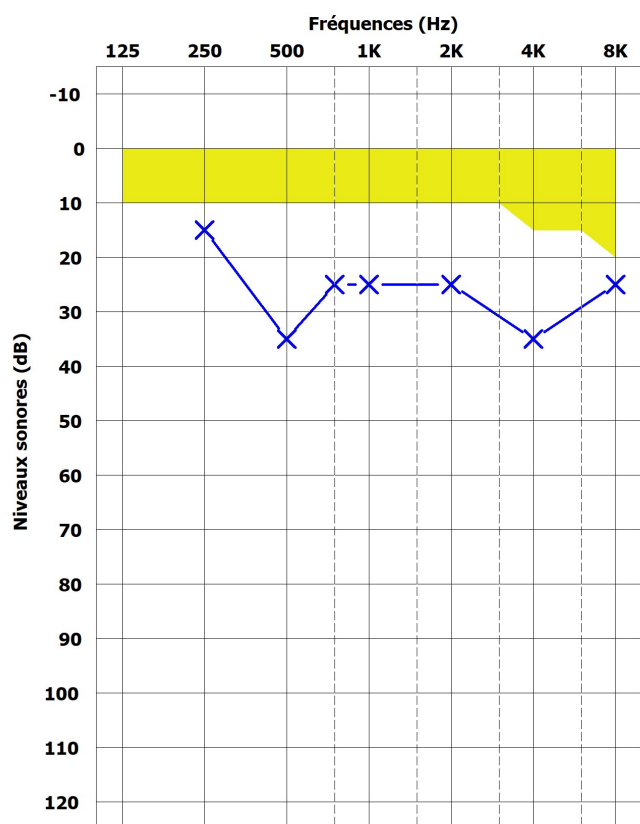

Oreille Gauche

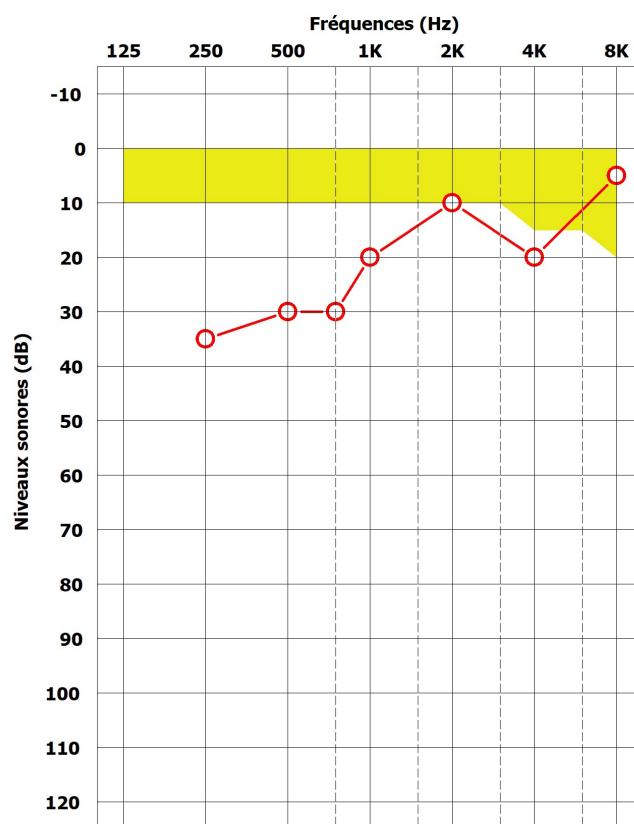

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	35	25	25		25		35		25
CA Droit		35	30	30	20		10		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	30,0 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes