

MEDVIE


Date du test: 07/03/2025 12:37:45

Durée: 4mn 15s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CHERIF FEREBORY
Date de naissance	15/02/1999
Age	26
Société	CR18
ID	25030712270368365

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

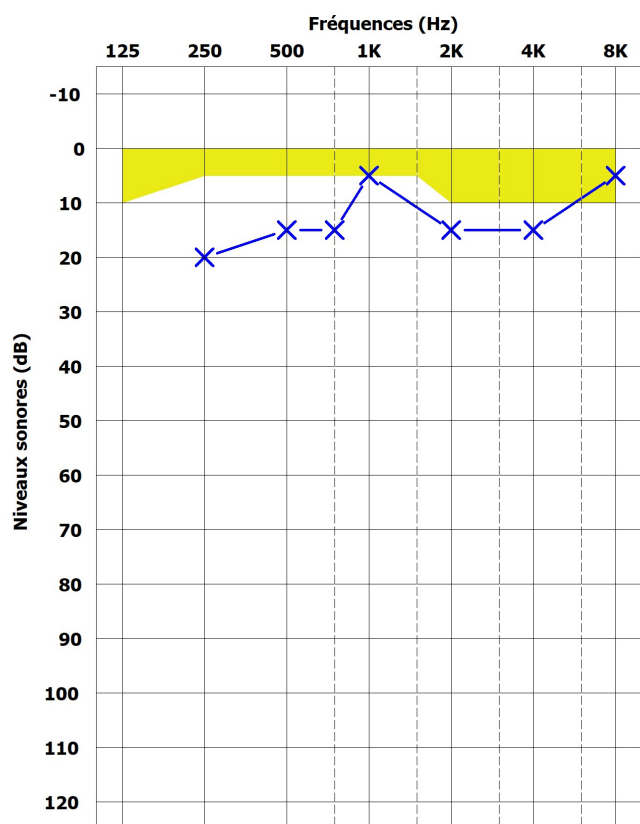

Oreille Gauche

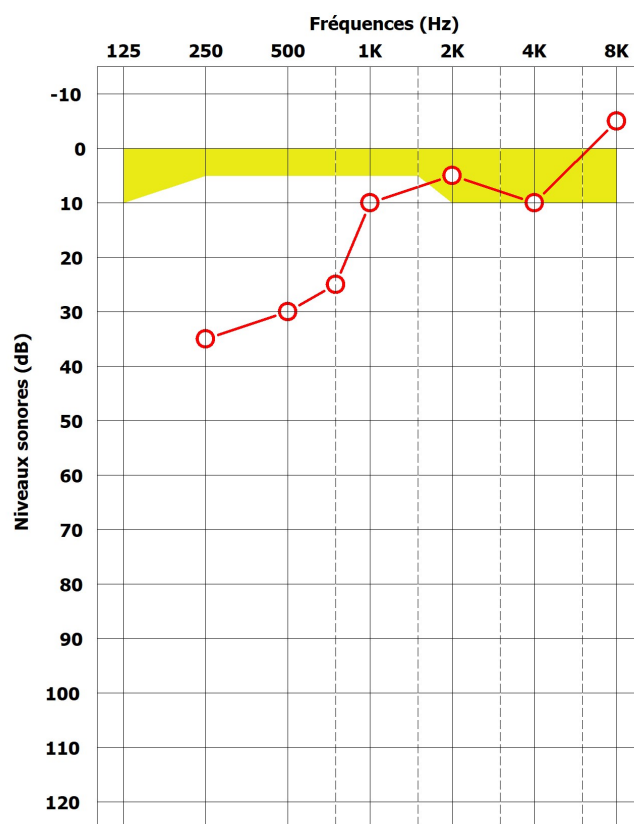

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	15	15	5		15		15		5
CA Droit		35	30	25	10		5		10		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes