

MEDVIE


Date du test: 29/03/2024 16:28:23

Durée: 10mn 59s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		BAMBA SERIMA
Date de naissance	21/01/1990	
Age	34	
Société	CR18	
ID	24032916222626701	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

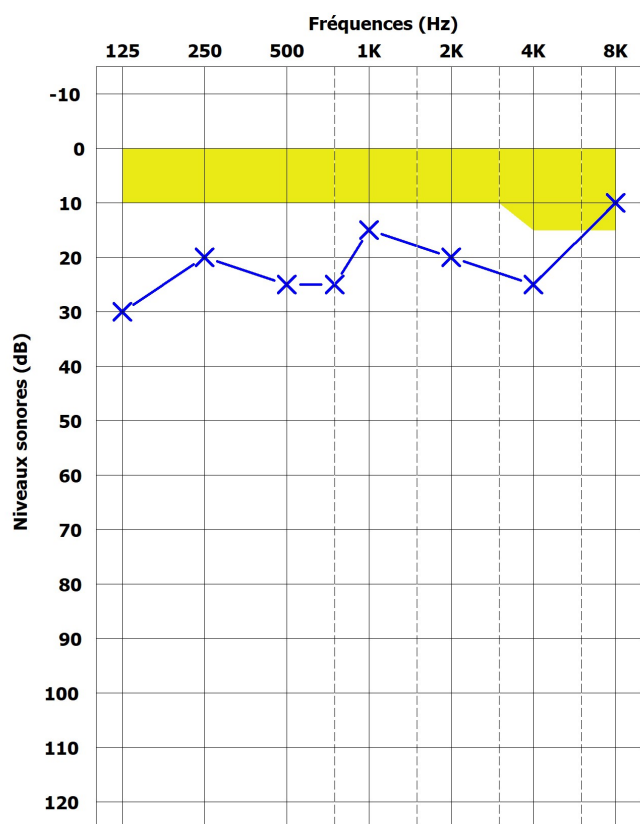

Oreille Gauche

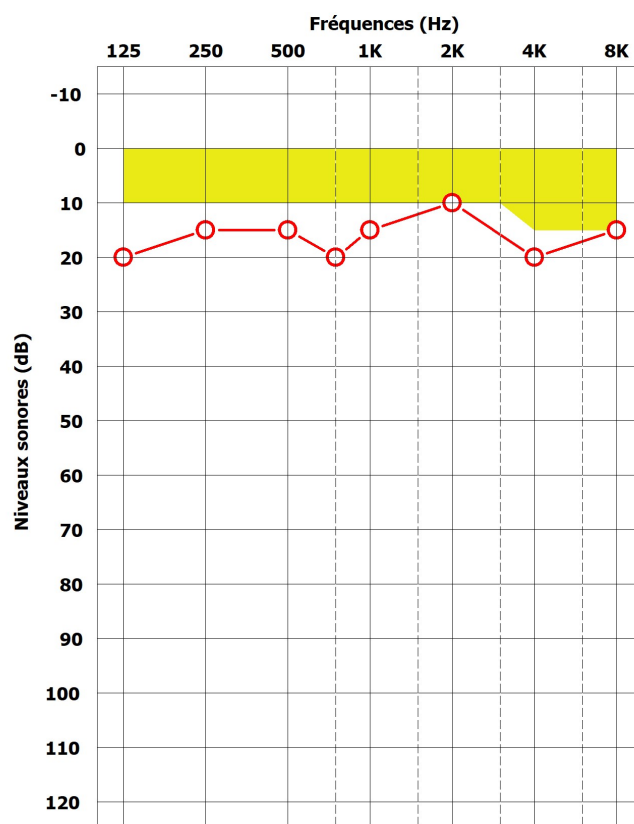

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	20	25	25	15		20		25		10
CA Droit	20	15	15	20	15		10		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes