


MEDVIE


Date du test: 20/05/2024 17:22:28
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		DIALLO SEKOU
Date de naissance	01/01/2007	
Age	17	
Société	CR18	
ID	24052017213943727	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

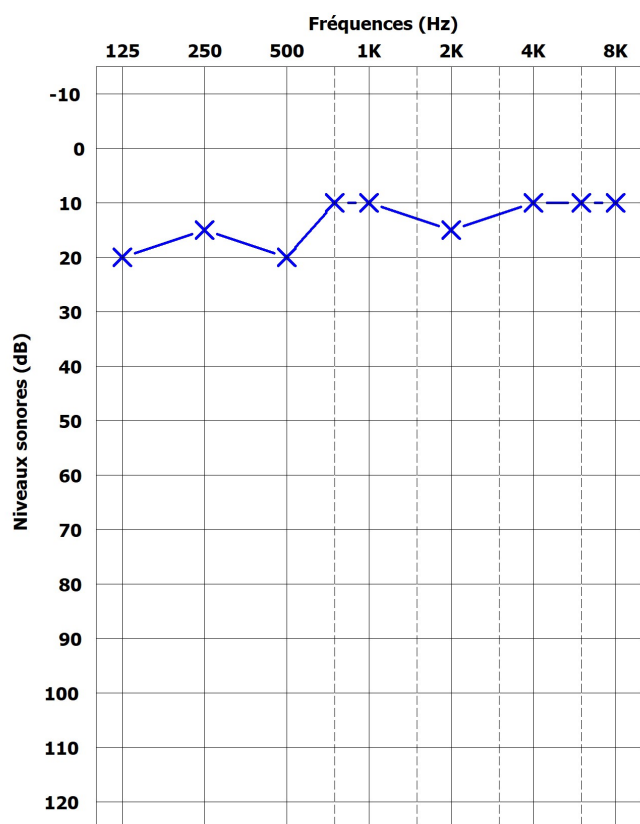

Oreille Gauche

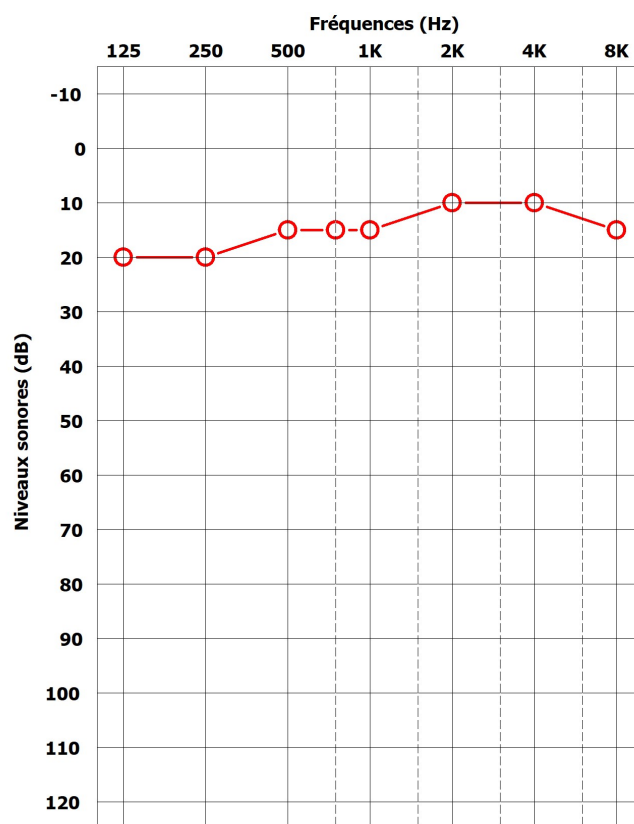

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	20	10	10		15		10	10	10
CA Droit	20	20	15	15	15		10		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes