


MEDVIE


Date du test: 05/07/2025 12:43:54
Durée: 6mn 24s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
ZHAO ZHANXIANG	
Date de naissance	08/06/1972
Age	53
Société	CR18
ID	25070512401625844

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

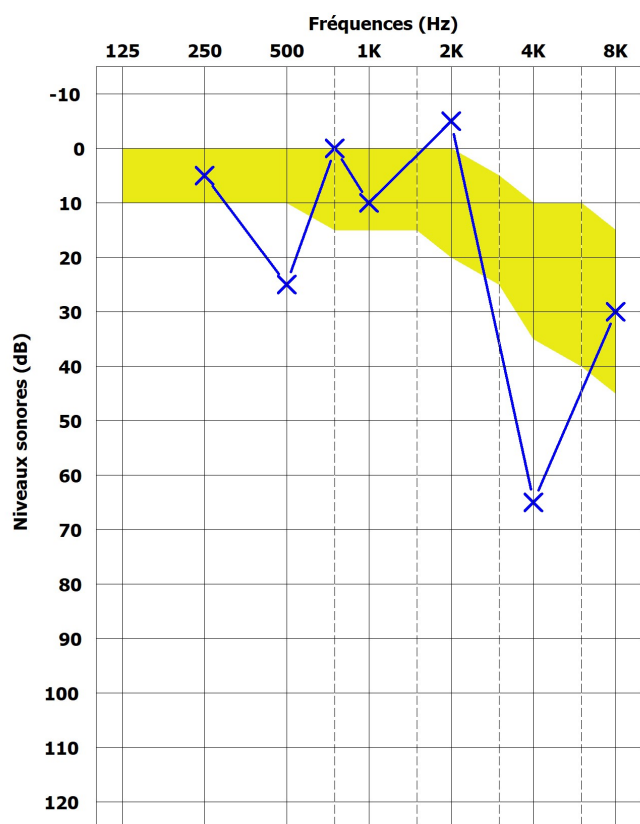

Oreille Gauche

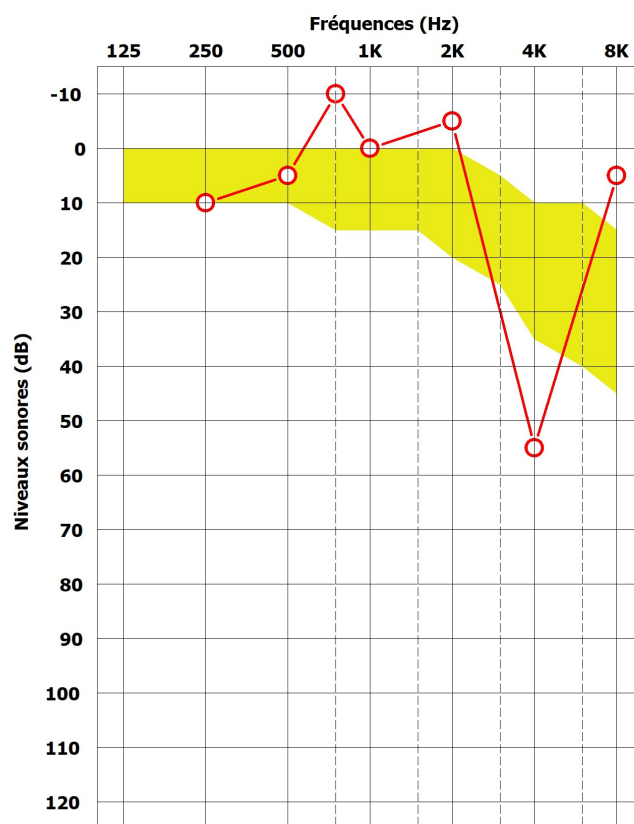

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	25	0	10		-5		65		30
CA Droit		10	5	-10	0		-5		55		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes