

Données Patient


CAMARA SEKOU

Date de naissance 01/01/1999
 Age 25
 Société CR18
 ID 24053116483447802


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
 Numéro de série: 2111EAT690093
 Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 31/05/2024 16:49:51
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

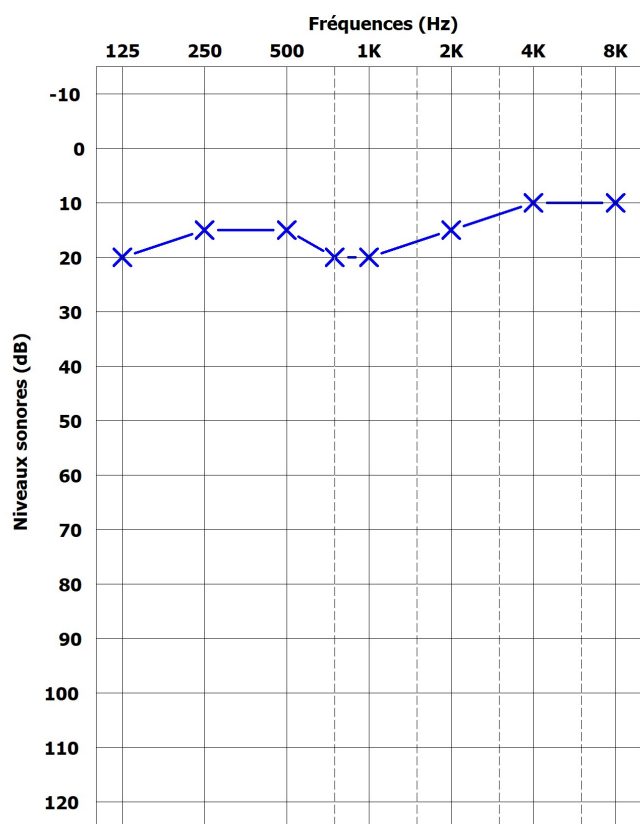

Oreille Gauche

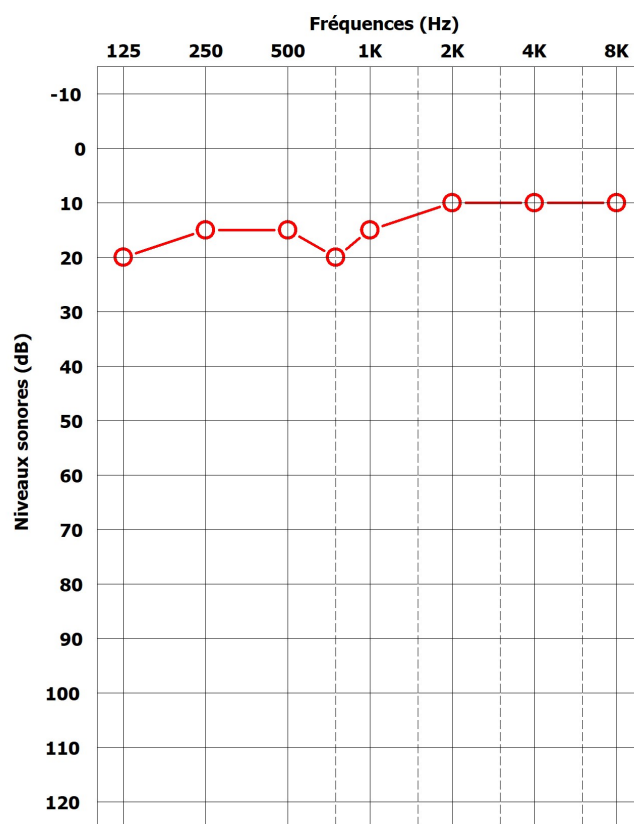

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	15	20	20		15		10		10
CA Droit	20	15	15	20	15		10		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes