

MEDVIE

Date du test: 01/06/2024 16:43:53

Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

Données Patient

TOURE FODE

Date de naissance 01/01/1994

Age 30

Société CR18


ID 24060116430118135

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

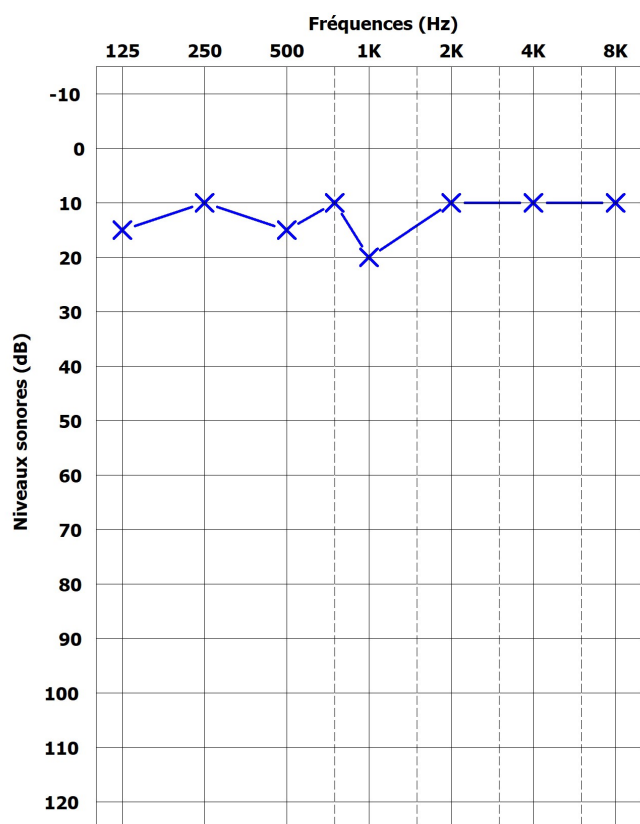

Oreille Gauche

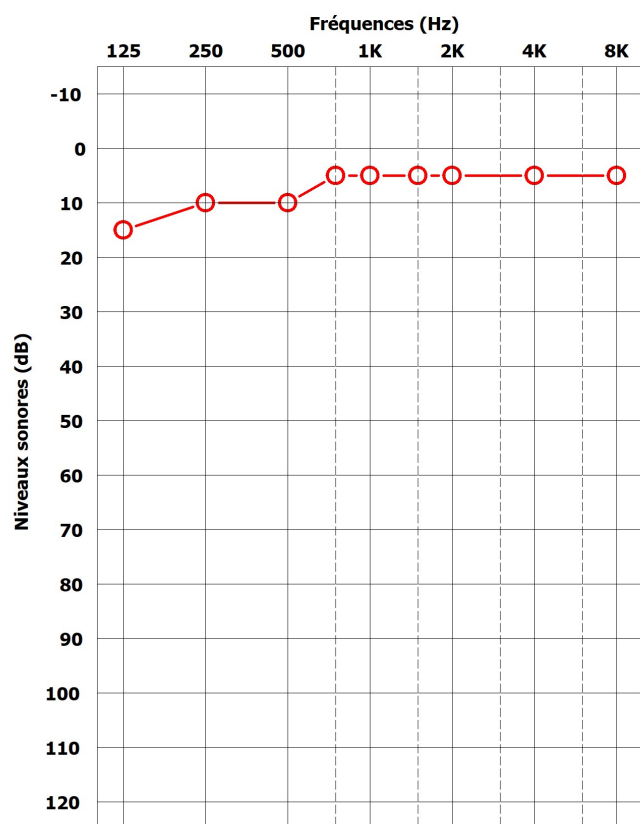

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	15	10	20		10		10		10
CA Droit	15	10	10	5	5	5	5		5		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes