

Données Patient

CHA YONGJIE

Date de naissance

05/05/1979

Age

46

Société

CR18

ID

25071310144813190

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690092

Date Calibration :


30/11/2021

Date du test: 13/07/2025 10:18:23


Durée: 5mn 29s

Type test

Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

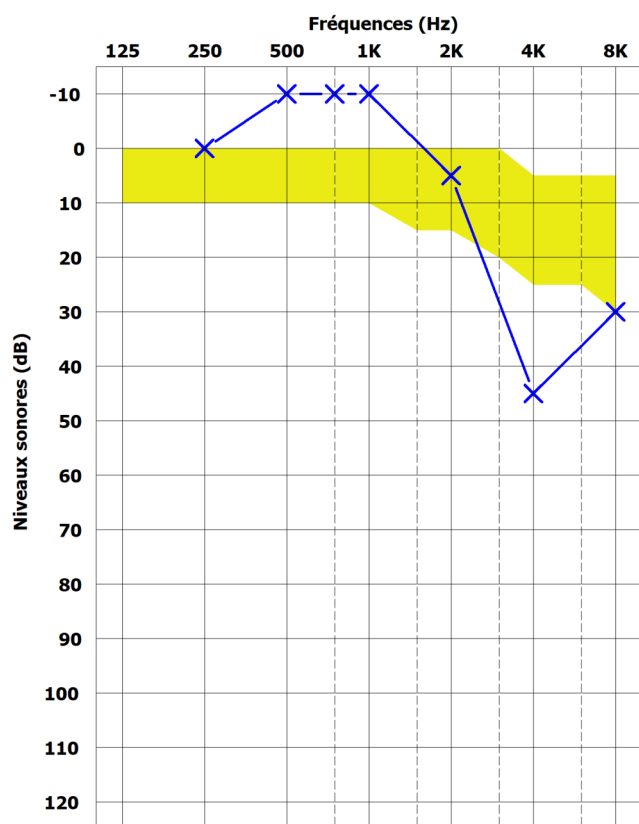

Oreille Gauche

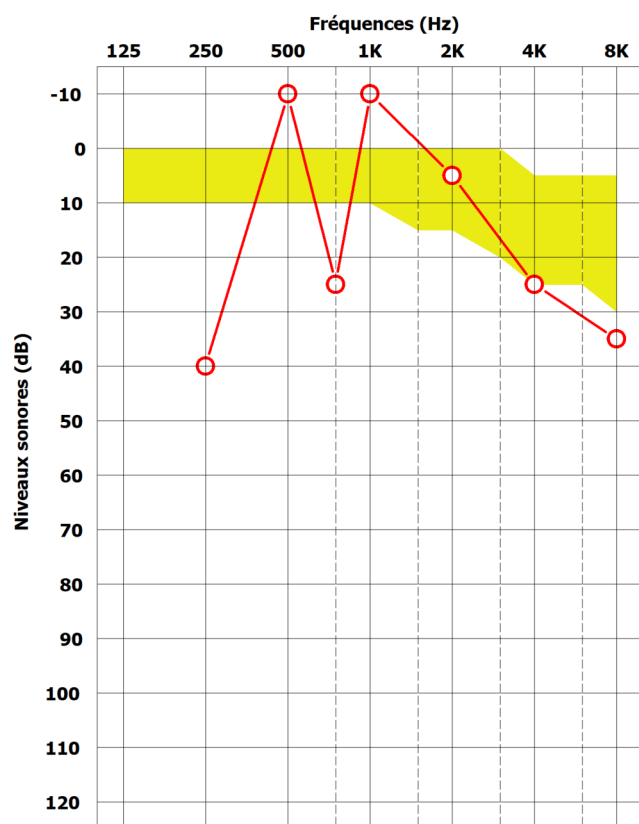

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	-10	-10	-10		5		45		30
CA Droit		40	-10	25	-10		5		25		35

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes