

MEDVIE

Date du test: 19/08/2025 15:03:57


Durée: 4mn 00s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient		CONDE KEMO
Date de naissance	02/02/2002	
Age	23	
Société	CR18	
ID	25081915010995393	

Audiomètre

Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

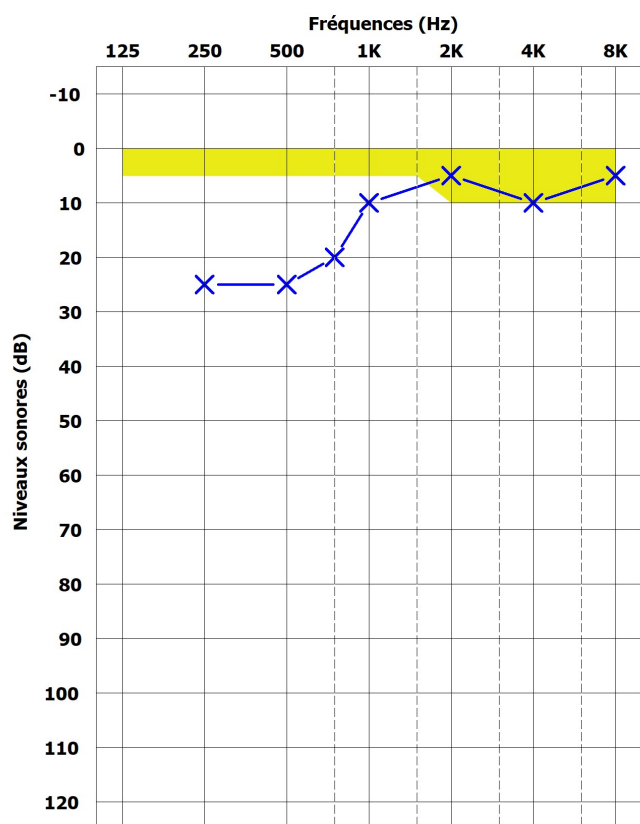

Oreille Gauche

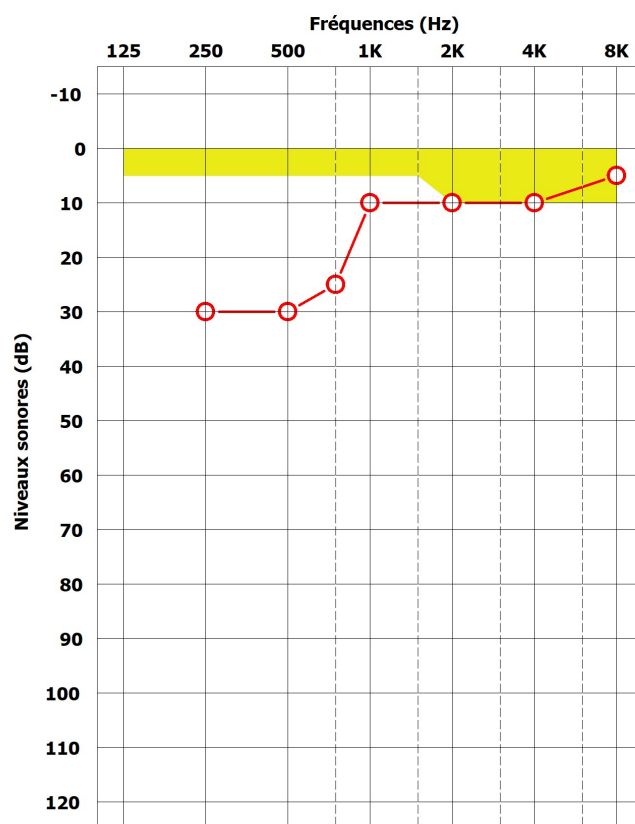

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	20	10		5		10		5
CA Droit		30	30	25	10		10		10		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes