


MEDVIE


Date du test: 02/05/2024 14:26:57
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	BONAMOU ABASS
Date de naissance	27/02/1997
Age	27
Société	CR18
ID	24050214213389106

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

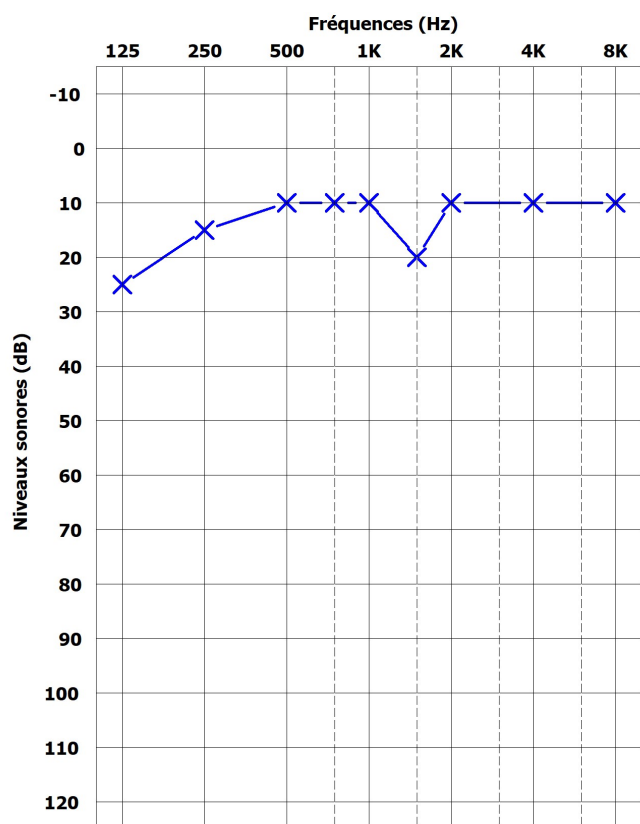

Oreille Gauche

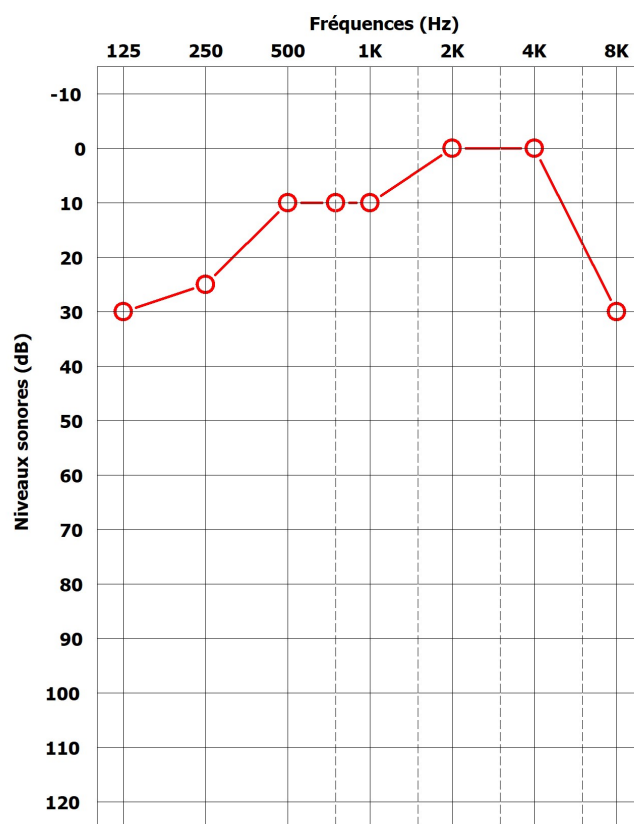

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	15	10	10	10	20	10		10		10
CA Droit	30	25	10	10	10		0		0		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes