

MEDVIE


Date du test: 09/04/2024 15:23:21

Durée: 14mn 12s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | TRAORE MORY       |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 10/04/2001        |
| Age               | 22                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 24040915175988111 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

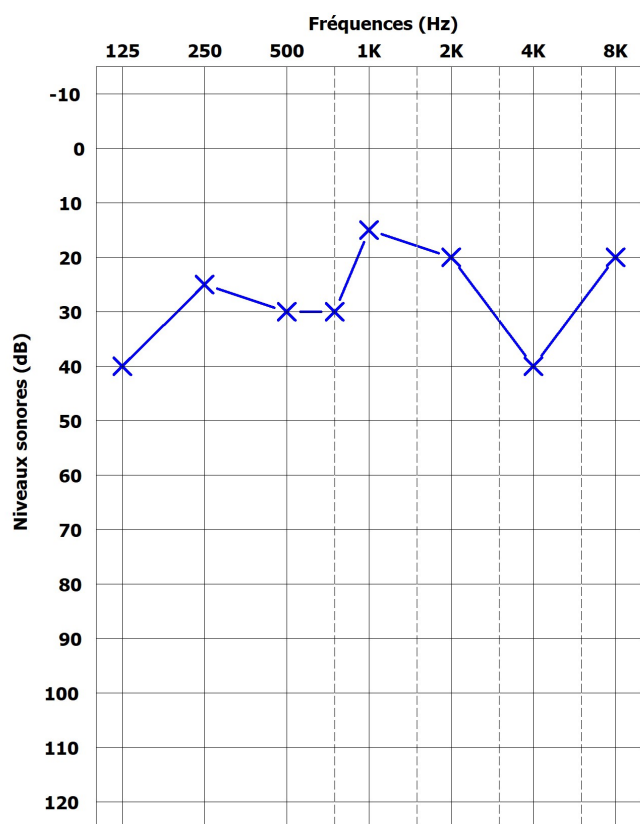

Oreille Gauche

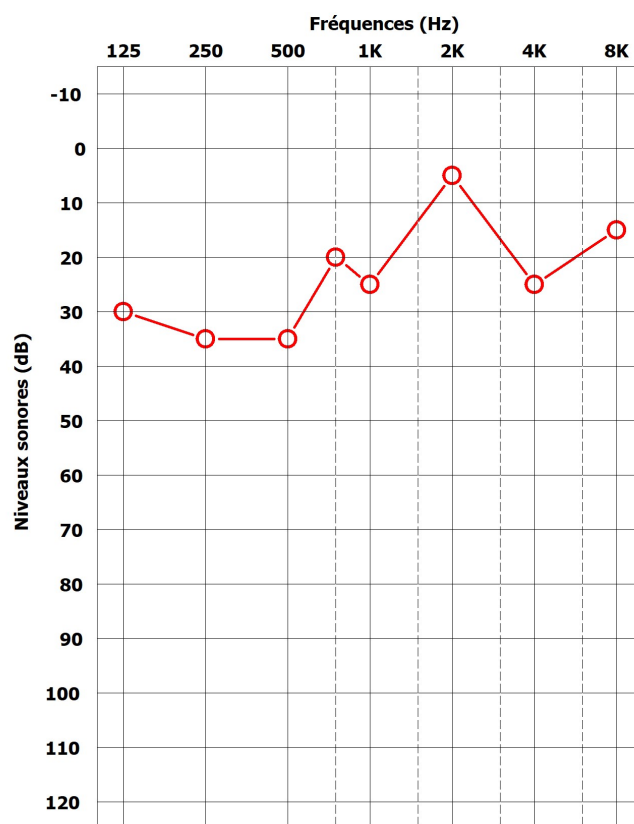

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 40  | 25  | 30  | 30  | 15 |     | 20 |    | 40 |    | 20 |
| CA Droit  | 30  | 35  | 35  | 20  | 25 |     | 5  |    | 25 |    | 15 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 26,3 dB | --- |
| CA Droit        | 22,5 dB | --- |

Notes