

Données Patient


BERETE TIDIANE

Date de naissance 01/01/1995
 Age 29
 Société CR18
 ID 24050813461603328


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
 Numéro de série: 2111EAT690093
 Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 08/05/2024 13:51:22
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

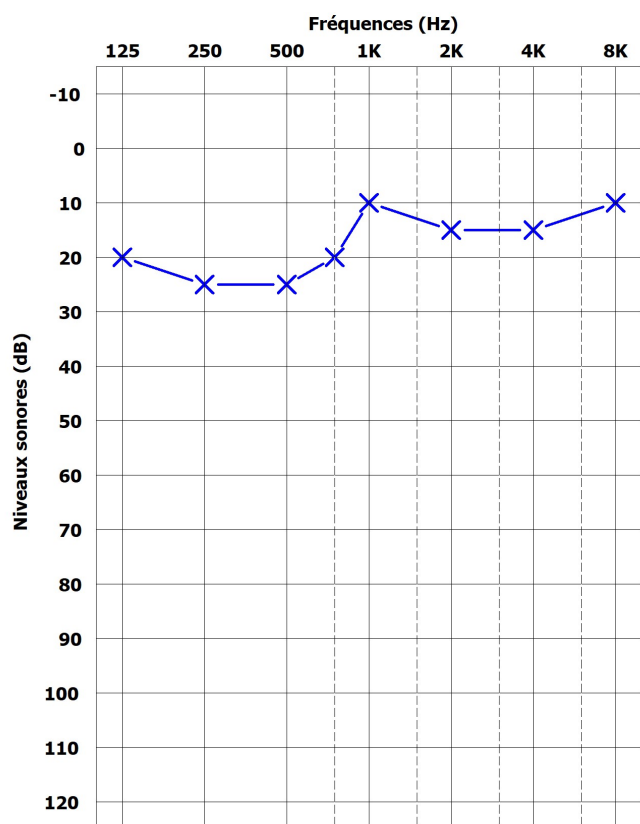

Oreille Gauche

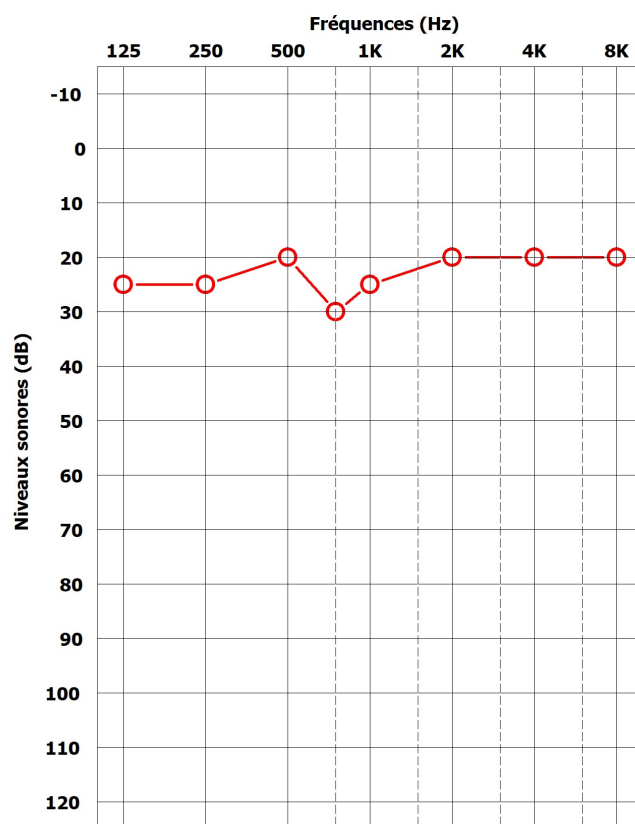

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	25	25	20	10		15		15		10
CA Droit	25	25	20	30	25		20		20		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes