

MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 13:25:19

Durée: 2mn 58s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE SIAKA
Date de naissance	01/01/1997	
Age	28	
Société	CR18	
ID	25031313084642930	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

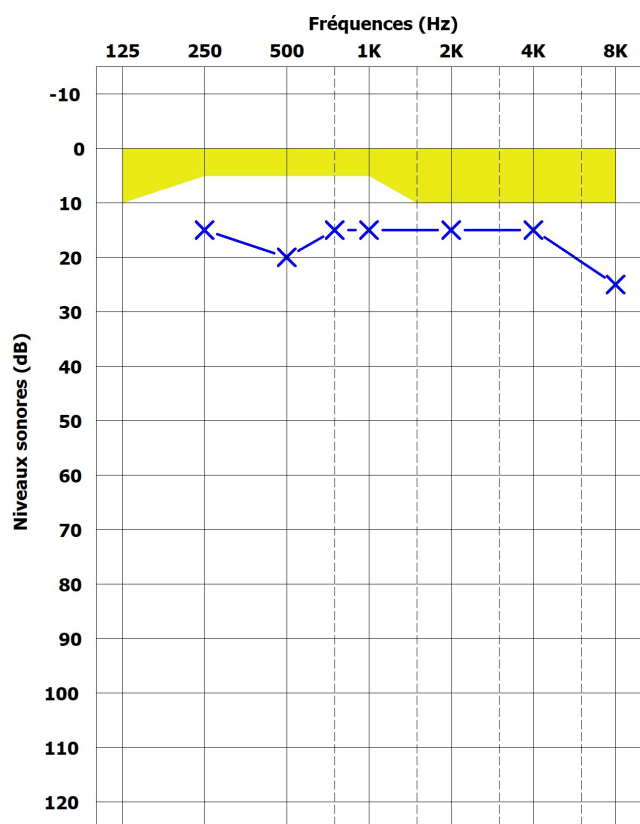

Oreille Gauche

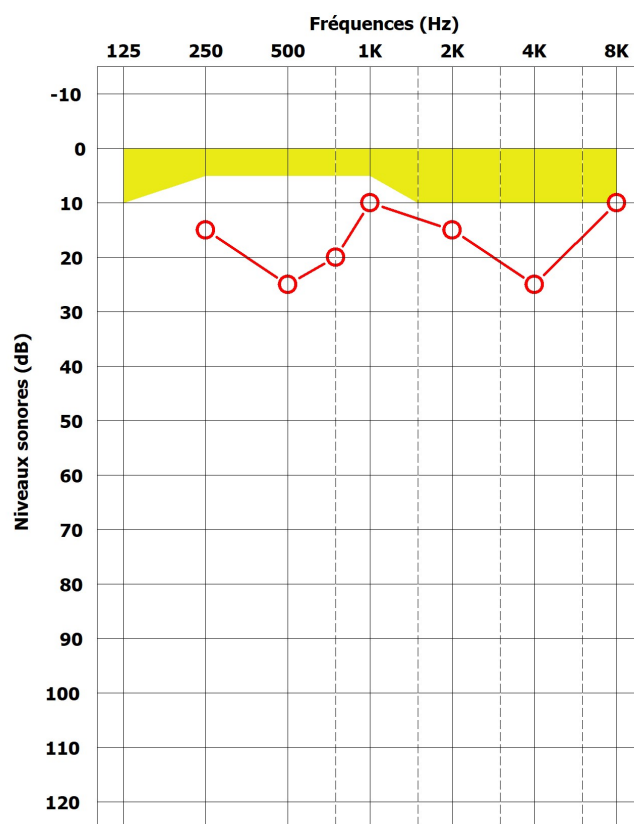

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	15	15		15		15		25
CA Droit		15	25	20	10		15		25		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes