


MEDVIE


Date du test: 31/05/2024 15:50:58
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient	
SANOH MOUSSA	
Date de naissance	01/01/2001
Age	23
Société	CR18
ID	24053115500016793

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

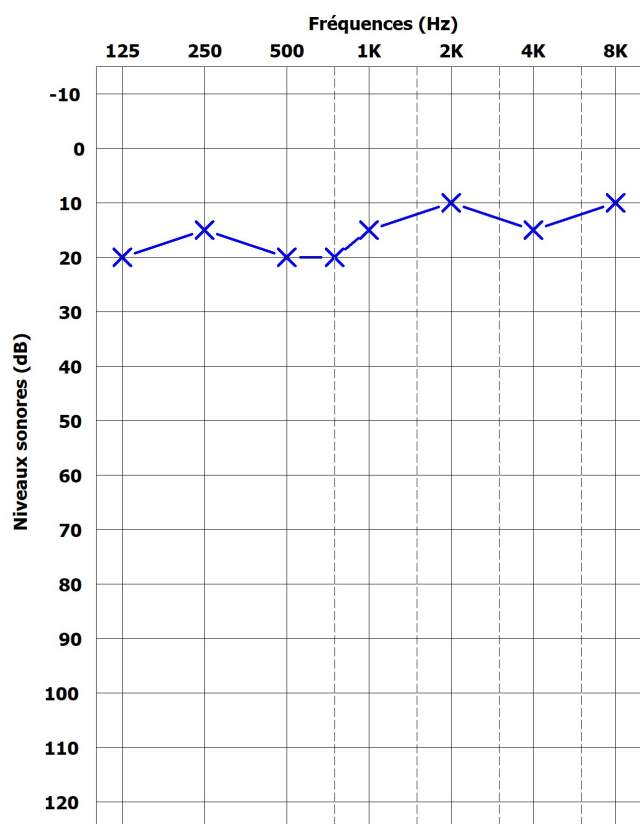

Oreille Gauche

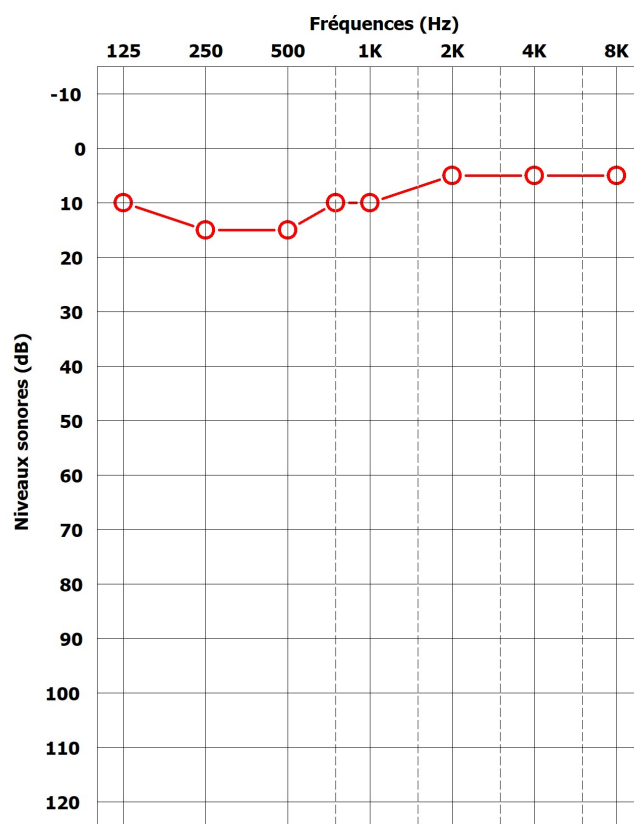

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	20	20	15		10		15		10
CA Droit	10	15	15	10	10		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes